

# PropGard™

Mouth Prop / DE - Mundsperrer / FR - Protège - langue / NL - Bijtblok / IT - Apribocca / ES - Sostén Bucal / PT - Abre - Bocas / SV - Munöppnare / DA - Mundspærer / FI - Purutuki / EL - Στοματοδιαστόλεας

## Description & Indications:

Use PropGard™ to hold mouth open and retract the tongue simultaneously.

## Procedure:

1. Insert right or left tongue guard in mouth piece. Choose appropriate slot for superior/inferior relationship best suited to each patient.
2. Right and left noted on side of tongue guard. "R" or "L" notation should be to posterior in correct position in patients mouth.
3. Using index finger, press in on tongue guard to retract tongue as needed.

Fig. 1 Assemble PropGard as shown.



EN

Insert right or left tongue positioner in mouth piece.

DE

Den rechten oder linken Zungenabhalter in den Mundsperrer einsetzen.

FR

Insérer le protège-langue droite ou gauche en bouche.

NL

Plaats de rechter of linker tongafhouder in het mondstuk.

IT

Inserire il posizionatore per la lingua destro o sinistro nell'imboccatura.

ES

Inserte el sostén de lengua, derecho o izquierdo, en la pieza bucal.

PT

Inserir posicionador lingual esquerdo ou direito na peça bucal.

SV

Sätt in höger eller vänster tunghållare i mun öppnaren.

DA

Indsæt højre eller venstre tungeholder i mundstykket.


FI

Kiinnitä oikean- tai vasemmanpuoleinen kielenpitiäjä puruteekseen.

EL

Tοποθετείτε τον απωθητή γλώσσας στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του στόματος.

Fig. 2 Position PropGard in mouth.

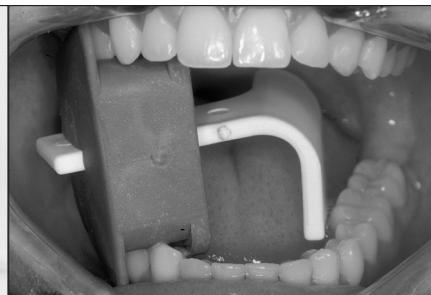

Using index finger; press in on tongue positioner to retract tongue as needed.

Mit dem Zeigefinger Zungenabhalter einschieben, um die Zunge so weit wie nötig abzudrängen.

A l'aide de votre index, appuyer en comprimant le protège-langue jusqu'à l'écartement lingual souhaité.

Druk met de wijsvinger de tongafhouder in om de tong in de gewenste positie te houden.

Per retrarre la lingua premere sul posiziona - lingua con il dito indice per quanto necessario.

Usando el dedo índice, presione sobre el sostén para contraer la lengua, según se necesite.

Utilizar dedo indicador; presionar no posicionador lingual para retrair língua conforme necessário.

Använd pekfinger; sätt in tunghållaren för att retrahera tungan vid behov.

Pres på tungeholderen med pegefingeren ved behov for at holde tungen længere væk.

Paina tarvitessa etusormella kielenpitiäjä pidemmälle niin, että se tulee kielta vasten.

Xρησιμοποιώντας τον δεξική πλευτέ τον απωθητή γλώσσας έτοι ώστε να απωθήσεται την γλώσσα δύο χρειάζεται.

## Cleaning & Sterilization Processing Instructions EN

Initial treatment at the time of use	Sterilization is required before every use.				
Cleaning	Place device in an ultrasonic cleaner with the detergent listed below:				
	<b>Detergent</b>	<b>Cleaning Time</b>			
	Henry Schein General Purpose Cleaner or equivalent product	2-10 mins			
Rinsing	Rinse device with warm water to remove detergent for 1-2 mins.				
Drying	Dry with gauze. Air dry 30 mins.				
Maintenance, inspection and testing	Visually inspect that the device is not bent or damaged and free of debris. If debris is present repeat cleaning process.				
Packaging	Place selected device in approved sterilization packaging (ISO11407 & ISO11607).				
Sterilization	Place sterilization package in autoclave using the following settings:				
	<b>Cycle Type</b>	<b>Minimum Sterilization Exposure Time</b>	<b>Minimum Sterilization Exposure Temperature</b>		
	Pre-vacuum	3 mins	132 °C / 270 °F		
	Do not overload the sterilizer.				
Storage	Keep device in sterilized packaging until ready for use. Keep out of sunlight and moisture.				
Additional information	If sterilization packaging is compromised, repeat sterilization process. This procedure was validated by an independent and accredited laboratory.				

## Instructions de traitement pour le nettoyage et la stérilisation FR

Traitement initial au moment de l'utilisation	Une stérilisation doit être effectuée avant chaque utilisation.				
Nettoyage	Placer l'appareil dans un dispositif de nettoyage à ultrasons avec le détergent indiqué ci-dessous :				
	<b>Déturgent</b>	<b>Durée de nettoyage</b>			
	Nettoyant tout usage Henry Schein ou produit équivalent	2 à 10 min			
Rinçage	Rincer l'appareil à l'eau tiède pour enlever le détergent pendant 1 à 2 minutes.				
Séchage	Sécher avec une gaze. Sécher à l'air pendant 30 minutes.				
Maintenance, inspection et test	Inspecter visuellement l'appareil pour confirmer qu'il n'est pas tordu, endommagé, ni encobré par des débris. Si des débris sont présents, répéter l'opération de nettoyage.				
Emballage	Placer l'appareil sélectionné dans un emballage de stérilisation approuvé (ISO11407 et ISO11607).				
Stérilisation	Placer l'emballage de stérilisation dans un autoclave en utilisant les paramètres suivants :				
	<b>Type de cycle</b>	<b>Durée minimale d'exposition de stérilisation</b>	<b>Température minimale d'exposition de stérilisation</b>		
	Pré-vide	3 min	132 °C / 270 °F		
	Ne pas surcharger le stérilisateur.				
Stockage	Stocker l'appareil dans un emballage stérilisé jusqu'à l'utilisation suivante. Tenir éloigné de la lumière du soleil et des moisissures.				
Informations supplémentaires	Si l'emballage de stérilisation est endommagé, répéter l'opération de stérilisation. Cette procédure a été validée par un laboratoire indépendant accrédité.				

## Verarbeitungsanleitung Reinigung und Sterilisierung DE

Reinigung	Erstbehandlung zum Zeitpunkt der Verwendung	Vor jedem Gebrauch ist eine Sterilisierung erforderlich.
	Instrument in ein Ultraschallbad mit den unten aufgeführten Reinigungsmittel geben:	
<b>Reinigungsmittel</b>		<b>Reinigungsduer</b>
Henry Schein Allzweckreiniger oder gleichwertiges Produkt		2-10 Min.
Ausspülen		Instrument zum Entfernen des Reinigungsmittels mit warmen Wasser 1-2 Min. lang ausspülen
Trocknen		Mit Gaze trocknen. 30 Minuten lang lufttrocknen lassen.
Instandhaltung, Inspektion und Test		Sichtprüfung durchführen, dass das Instrument nicht verbogen, schadhafte und frei von Ablagerungen ist. Bei vorhandenen Ablagerungen den Reinigungsvorgang wiederholen.
Verpackung		Das ausgewählte Instrument in eine zugelassene Sterilisationsverpackung (ISO11407 und ISO11607) legen.
Sterilisierung		Sterilisierungsverpackung in Autoklav geben und folgende Einstellungen verwenden:
		<b>Zyklusart</b> <b>Mindestwert Einwirkungszeit für Sterilisierung</b> <b>Mindestwert Einwirkungstemperatur für Sterilisierung</b> <b>Mindestzeit für das Trocknen</b>
Vorvakuum		3 Min. 132 °C / 270 °F 20 Min.
Den Sterilisator nicht überladen.		
Lagerung		Instrument in sterilisierter Verpackung lassen, bis es gebrauchsfertig ist. Von Sonnenlicht und Feuchtigkeit fernhalten.
Zusätzliche Angaben		Den Sterilisierungsvorgang wiederholen, falls die Sterilisationsverpackung beeinträchtigt ist. Dieses Verfahren wurde durch ein unabhängiges und zugelassenes Labor validiert.

## Verwerkingshandleiding voor reiniging en sterilisatie NL

Reiniging	Erste behandeling op het moment van gebruik	Sterilisatie is vereist voor elk gebruik.
		Plaats het apparaat in een ultrasone reiniger met het onderstaande detergent:
<b>Detergent</b>		<b>Reinigingsduur</b>
Henry Schein allezreiniger of een gelijksortig product		2-10 min
Spoelen		Spoel het apparaat met warm water gedurende 1-2 minuten om het detergent te verwijderen.
Drogen		Droog af met een doekje. Laat 30 minuten aan de lucht drogen.
Onderhoud, controle en testen		Kijk na of het apparaat niet gebogen of beschadigd is en vrij is van vuil. Herhaal het reinigingsproces als er nog vuilstonten te zien zijn.
Verpakking		Zet het geselecteerde apparaat in een goedgekeurde sterilisatieverpakking (ISO11407 en ISO11607).
Sterilisatie		Plaats het sterilisatiepakket in een autoclaf met behulp van de volgende instellingen:
		<b>Cyclustype</b> <b>Minimale sterilisatieduur</b> <b>Minimale sterilisatieterminatuur</b> <b>Minimale droogtijd</b>
Pre-vakuum		3 minuten 132°C / 270°F 20 minuten
Overlaad de sterilisator niet.		
Bewaring		Bewaar het apparaat in een steriele verpakking tot het klaar is voor gebruik. Houd het uit de buurt van zonlicht en vocht.
Aanvullende informatie		Herhaal het sterilisatieproces als de sterilisatieverpakking aangegetast is. Deze procedure werd gevalideerd door een onafhankelijk en erkend laboratorium.

Istruzioni per il trattamento di pulizia e sterilizzazione		IT								
Trattamento iniziale al momento dell'uso	Prima di ogni utilizzo, è necessaria la sterilizzazione.									
Pulizia	Collocare il dispositivo in un pulitore a ultrasuoni con il detergente elencato di seguito:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Detergente</th><th>Tempo di pulizia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Henry Schein Detergente per uso generico o prodotto equivalente</td><td>2-10 min</td></tr> </tbody> </table>	Detergente	Tempo di pulizia	Henry Schein Detergente per uso generico o prodotto equivalente	2-10 min					
Detergente	Tempo di pulizia									
Henry Schein Detergente per uso generico o prodotto equivalente	2-10 min									
Risciacquo	Risciacquare il dispositivo con acqua calda per rimuovere il detergente per 1-2 minuti.									
Asciugatura	Asciugare con una garza. Asciugare all'aria 30 minuti.									
Mantenzione, ispezione e prova	Ispezionare visivamente che il dispositivo non sia piegato, danneggiato e privo di detriti. Se sono presenti detriti, ripetere il procedimento di pulizia.									
Confezione	Porre il dispositivo selezionato nella confezione approvata per la sterilizzazione (ISO11407 e ISO11607).									
Sterilizzazione	Mettere la confezione per la sterilizzazione in autoclave utilizzando le seguenti impostazioni:  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo di ciclo</th><th>Tempo di esposizione minimo alla sterilizzazione</th><th>Temperatura minima alla sterilizzazione</th><th>Tempo di asciugatura minimo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prevuoto</td><td>3 min</td><td>132°C / 270°F</td><td>20 min</td></tr> </tbody> </table> <p>Non sovraccaricare lo sterilizzatore.</p>	Tipo di ciclo	Tempo di esposizione minimo alla sterilizzazione	Temperatura minima alla sterilizzazione	Tempo di asciugatura minimo	Prevuoto	3 min	132°C / 270°F	20 min	
Tipo di ciclo	Tempo di esposizione minimo alla sterilizzazione	Temperatura minima alla sterilizzazione	Tempo di asciugatura minimo							
Prevuoto	3 min	132°C / 270°F	20 min							
Conservazione	Conservare la dispositio nel confezione sterilizzata finché non è pronto per l'uso. Tenere lontano dalla luce solare e dall'umidità.									
Informazioni aggiuntive	Se la confezione per la sterilizzazione è compromessa, ripetere il processo di sterilizzazione. Questa procedura ha sido validato por un laboratorio independiente y acreditado.									

Instrucciones de procesamiento de limpieza y esterilización		ES								
Tratamiento inicial en el momento de su uso	Se requiere esterilización antes de cada uso.									
Limpieza	Coloque el dispositivo en un limpiaultrasonido con el detergente listado a continuación:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Detergente</th><th>Tiempo de limpieza</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpiaultrasonido General Henry Schein o producto equivalente</td><td>2 a 10 mins</td></tr> </tbody> </table>	Detergente	Tiempo de limpieza	Limpiaultrasonido General Henry Schein o producto equivalente	2 a 10 mins					
Detergente	Tiempo de limpieza									
Limpiaultrasonido General Henry Schein o producto equivalente	2 a 10 mins									
Enjuague	Enjuague el dispositivo con agua caliente para eliminar el detergente durante 1 a 2 minutos.									
Secado	Seque con una gasa. Seque al aire durante 30 mins.									
Mantenimiento, inspección y prueba	Inspeccione visualmente el dispositivo para comprobar que no está doblado o dañado y esté libre de residuos. Si observa residuos, repita el proceso de limpieza.									
Embalaje	Coloque el dispositivo seleccionado en un embalaje de esterilización aprobado (ISO11407 y ISO11607).									
Esterilización	Coloque el paquete de esterilización en el autoclave usando los siguientes ajustes:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de ciclo</th><th>Tempo de exposición a esterilización mínimo</th><th>Temperatura mínima de exposición a esterilización</th><th>Tempo de secado mínimo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pre-vácuo</td><td>3 mins</td><td>132°C / 270°F</td><td>20 mins</td></tr> </tbody> </table> <p>No sobrecargue el esterilizador.</p>	Tipo de ciclo	Tempo de exposición a esterilización mínimo	Temperatura mínima de exposición a esterilización	Tempo de secado mínimo	Pre-vácuo	3 mins	132°C / 270°F	20 mins	
Tipo de ciclo	Tempo de exposición a esterilización mínimo	Temperatura mínima de exposición a esterilización	Tempo de secado mínimo							
Pre-vácuo	3 mins	132°C / 270°F	20 mins							
Almacenamiento	Mantenga el dispositivo en su paquete esterilizado hasta su uso. Mantenga alejado de la luz solar y la humedad.									
Información adicional	Si el embalaje de esterilización está dañado, repita el proceso de esterilización. Este procedimiento ha sido validado por un laboratorio independiente y acreditado.									

Instruções de Processamento de Limpeza e Esterilização		PT								
Tratamento inicial no momento da utilização	É necessário fazer uma esterilização antes de cada utilização.									
Limpieza	Coloque o dispositivo num limpador ultrassônico com o detergente listado abaixo:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Detergente</th><th>Tempo de limpeza</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detergente de uso geral Henry Schein ou produto equivalente</td><td>2-10 minutos</td></tr> </tbody> </table>	Detergente	Tempo de limpeza	Detergente de uso geral Henry Schein ou produto equivalente	2-10 minutos					
Detergente	Tempo de limpeza									
Detergente de uso geral Henry Schein ou produto equivalente	2-10 minutos									
Enxaguar	Enxágue o aparelho com água morna para remover o detergente durante 1-2 minutos.									
Secar	Seque com gaze. Seque ao ar durante 30 minutos.									
Mantenimento, inspeção e teste	Inspeccione visualmente se o dispositivo não está deformado ou danificado e se está livre de detritos. Se existirem detritos repita o processo de limpeza.									
Embalagem	Coloque o dispositivo selecionado na embalagem de esterilização aprovada (ISO11407 e ISO11607).									
Esterilização	Coloque o pacote de esterilização em um autoclave usando as seguintes configurações:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tempo do ciclo</th><th>Tempo mínimo de exposição à esterilização</th><th>Temperatura mínima de exposição à esterilização</th><th>Tempo de secagem mínimo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pré-vácuo</td><td>3 minutos</td><td>132°C / 270°F</td><td>20 minutos</td></tr> </tbody> </table> <p>Não sobrecarregue o esterilizador.</p>	Tempo do ciclo	Tempo mínimo de exposição à esterilização	Temperatura mínima de exposição à esterilização	Tempo de secagem mínimo	Pré-vácuo	3 minutos	132°C / 270°F	20 minutos	
Tempo do ciclo	Tempo mínimo de exposição à esterilização	Temperatura mínima de exposição à esterilização	Tempo de secagem mínimo							
Pré-vácuo	3 minutos	132°C / 270°F	20 minutos							
Armazenamento	Mantenha o dispositivo na embalagem esterilizada até estar pronto para uso. Mantenha protegido do calor e da umidade.									
Informação adicional	Se a embalagem de esterilização estiver comprometida, repita o processo de esterilização. Este procedimento foi validado por um laboratório independente e credenciado.									

Instruktioner för rengöring och sterilisering		SV								
Första behandling vid tiden för användning	Sterilisering krävs före varje användning.									
Rengöring och skötsel	Placer enheten i en rengöringsapparat med ultraljud till sammans med nedan angivet rengöringsmedel:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rengöringsmedel</th><th>Rengöring och skötsel</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Henry Schein rengöringsmedel för allmänt bruk eller likvärdig produkt</td><td>2-10 min.</td></tr> </tbody> </table>	Rengöringsmedel	Rengöring och skötsel	Henry Schein rengöringsmedel för allmänt bruk eller likvärdig produkt	2-10 min.					
Rengöringsmedel	Rengöring och skötsel									
Henry Schein rengöringsmedel för allmänt bruk eller likvärdig produkt	2-10 min.									
Sköljning	Skölj enheten i varmt vatten i 2 min. fört att avlägsna rengöringsmedel.									
Torkning	Torka av med gasväv. Lufttorka i 30 min.									
Underhåll, inspektion och testning	Kontrollera visuellt att enheten inte är krökta, skadad eller smutsig. Om den är smutsig, upprepas rengöringen.									
Förpackning	Placer enligt vald enhet i godkänd steriliseringförpackning (ISO11407 och ISO11607).									
Sterilisering	Placer steriliseringförpackningen i autoclav med följande inställningar:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cykeltyp</th><th>Minimumpressureringstid för sterilisering</th><th>Minimums temperatur för sterilisering</th><th>Minimumpartitionstid</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Förvarukunn.</td><td>3 min.</td><td>132 °C</td><td>20 min.</td></tr> </tbody> </table> <p>Överlasta inte sterilisatorn.</p>	Cykeltyp	Minimumpressureringstid för sterilisering	Minimums temperatur för sterilisering	Minimumpartitionstid	Förvarukunn.	3 min.	132 °C	20 min.	
Cykeltyp	Minimumpressureringstid för sterilisering	Minimums temperatur för sterilisering	Minimumpartitionstid							
Förvarukunn.	3 min.	132 °C	20 min.							
Lagring	Förvara enheten i den steriliserade förpackningen tills den är klar för användning. Håll borta från solljus och fukt.									
Ytterligare information	Om steriliseringförpackningen är skadad uppgeras steriliseringen. Denna procedur verdueras av ett oberoende och akkrediterat laboratorium.									

Vejledning om rengøring og sterilisering ved bearbejdning		DA								
Indledende behandling ved anvendelsesstedspunktet	Sterilisering er påkrævet inden enhver brug.									
Rengøring	Anbring enheden i en ultralydsrenser med den detergent, der er anført nedenfor:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Detergent</th><th>Rensningstid</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Henry Schein rengøringsmedel til generelt brug eller tilsvarende produkt</td><td>2-10 min.</td></tr> </tbody> </table>	Detergent	Rensningstid	Henry Schein rengøringsmedel til generelt brug eller tilsvarende produkt	2-10 min.					
Detergent	Rensningstid									
Henry Schein rengøringsmedel til generelt brug eller tilsvarende produkt	2-10 min.									
Skyllning	Skyl enheden med varmt vand i 1-2 minutter for at fjerne detersenten.									
Tørring	Tør med gaze. Lufttør i 30 min.									
Vedligeholdelse, inspektion og testing	Kontroller visuelt, at enheden ikke er bojet eller beskadiget og fri for snays. Hvis der er snays, skal rengøringsprocessen gentages.									
Emballage	Placer den valgte enhed i godkendt steriliseringsemballage (ISO11407 og ISO11607).									
Sterilisation	Anbring steriliseringspakke i autoclave ved hjælp af følgende indstillingen:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cykeltid</th><th>Minimal eksponeringstid for sterilisering</th><th>Minimal eksponeringstid for sterilisering</th><th>Minimal torretid</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prævakuum</td><td>3 min.</td><td>132°C / 270°F</td><td>20 min.</td></tr> </tbody> </table> <p>Sterilisatoren må ikke overbelastes.</p>	Cykeltid	Minimal eksponeringstid for sterilisering	Minimal eksponeringstid for sterilisering	Minimal torretid	Prævakuum	3 min.	132°C / 270°F	20 min.	
Cykeltid	Minimal eksponeringstid for sterilisering	Minimal eksponeringstid for sterilisering	Minimal torretid							
Prævakuum	3 min.	132°C / 270°F	20 min.							
Opbevaring	Opbevar enheden i steriliseret emballage, indtil den er klar til brug. Hold produktet væk fra sollys og fugt.									
Yderligere oplysninger	Hvis steriliseringsemballagen er kompromitteret, skal rengøringsprocessen gentages. Denne procedure blev valideret af et uafhængigt og akkrediteret laboratorium.									

Puhdistus- ja steriloointiohjeet		FI						
Aloitushoitto käytön alkana	Steriloointi on välttämätöntä ennen jokaista käyttötäusta.							
Puhdistus ja hoito	Aseta laite ultrahänipuidistimeen ja lisää alla mainittuina puhdistusaietta:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Puhdistusaine</th><th>Puhdistus ja hoito</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Henry Schein-yleispuhdistusaine tai muu vastaava tuote</td><td>2-10 min</td></tr> </tbody> </table>	Puhdistusaine	Puhdistus ja hoito	Henry Schein-yleispuhdistusaine tai muu vastaava tuote	2-10 min			
Puhdistusaine	Puhdistus ja hoito							
Henry Schein-yleispuhdistusaine tai muu vastaava tuote	2-10 min							
Huuhtelu	Poista puhdistusaine huuhtelemaan laitetta lämpimällä vedellä 1-2 min ajan.							
Kuivaus	Kuivaa sidebarsolla. Ilmakuivaus 30 min.							
Ylläpito, tarkastus ja kokemu	Tarkista silmämääriäisesti, että laite ei ole taipunut, vauroitunut eikä siinä ole jäanteitä. Mikäli laitteessa on jäanteitä, puhdistus se uudelleen.							
Pakkaus	Laita laite hyväksyttyyn sterilointipakkaukseen (ISO11407 ja ISO11607).							
Sterilointi	Laita sterilointipakkauksen autoklaaviin ja käytä seuraavia asetuksia:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaksotyppi</th><th>Steriloinnillinen autoklaavien käytäminen vähimmäislämpötilalla</th><th>Kuivausaika vähintään</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pre-tyhjöjö</td><td>3 min</td><td>132°C / 270°F</td></tr> </tbody> </table> <p>Älä kuormita steriloitaan liikaa.</p>	Jaksotyppi	Steriloinnillinen autoklaavien käytäminen vähimmäislämpötilalla	Kuivausaika vähintään	Pre-tyhjöjö	3 min	132°C / 270°F	
Jaksotyppi	Steriloinnillinen autoklaavien käytäminen vähimmäislämpötilalla	Kuivausaika vähintään						
Pre-tyhjöjö	3 min	132°C / 270°F						
Varastointi	Pidä laite sterilointipakkauksessa kunnnes se on käytövalmis. Säilytä irtosäilytysvaloista ja kosteudesta.							
Lisätiedot	Jos sterilointipakkauksen vaariontuitut, te steriloointi uudelleen. Itseäni ja akkreditoitu laboratorio on vahvistanut nämä toimintaohjeet.							

Οδηγίες επεξεργασίας για καθαρισμό & αποστέρωση		EL						
Αρχική επεξεργασία κατά τον χρόνο χρήσης	Απαιτείται αποστέρωση πριν από κάθε χρήση.							
Καθαρισμός	Τοποθίζεται το πρώτο σε συσκευή καθαρισμού με υπέρχους, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω απορρυπαντικά:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Απορρυπαντικό</th><th>Χρόνος καθαρισμού</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Καθαριστικό Henry Schein γενικής χρήσης ή αντιστοιχο πρώτο</td><td>2-10 λεπτά</td></tr> </tbody> </table>	Απορρυπαντικό	Χρόνος καθαρισμού	Καθαριστικό Henry Schein γενικής χρήσης ή αντιστοιχο πρώτο	2-10 λεπτά			
Απορρυπαντικό	Χρόνος καθαρισμού							
Καθαριστικό Henry Schein γενικής χρήσης ή αντιστοιχο πρώτο	2-10 λεπτά							
Εκπλυση	Εκπλύνεται το πρώτο με χιλιόρι ύψη για 1-2 λεπτά, για να απομακρύνεται το απορρυπαντικό.							
Στεγώμα	Στεγώνεται ο καπούτζας με γάζα. Αργήτε το να στεγώνεται στον αέρα για 30 λεπτά.							
Συντήρηση επιθεώρηση και έλεγχος	Επιθεώρησης οπτικά το πρώτο και βεβαιώθετε ότι δεν είναι λιγότερον η φθοράμενο και δεν έχει ματαίωση. Αν υπάρχουν καταλύτα, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού.							
Αποστέρωση	Τοποθίζεται τη συσκευασία αποστέρωσης σε αυτόκαυτο λύμαν με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Έλάχιστος χρόνος έκθεσης σε αποστέρωση</th><th>Έλαχιστη θερμοκρασία έκθεσης σε αποστέρωση</th><th>Έλάχιστος χρόνος στεγώματος</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Προκαρακτικό κενό</td><td>3 λεπτά</td><td>132°C / 270°F</td></tr> </tbody> </table> <p>Do not overload the sterilizer.</p>	Έλάχιστος χρόνος έκθεσης σε αποστέρωση	Έλαχιστη θερμοκρασία έκθεσης σε αποστέρωση	Έλάχιστος χρόνος στεγώματος	Προκαρακτικό κενό	3 λεπτά	132°C / 270°F	
Έλάχιστος χρόνος έκθεσης σε αποστέρωση	Έλαχιστη θερμοκρασία έκθεσης σε αποστέρωση	Έλάχιστος χρόνος στεγώματος						
Προκαρακτικό κενό	3 λεπτά	132°C / 270°F						
Αποθήκευση	Διατηρείται το πρώτο επίπεδο της αποστέρωσης συσκευασίας μέχρι τη χρήση. Να διατηρείται μακριά από τη γηραιά ακτινοβολία και την υγρασία.							
Επιπλέον πληροφορίες	Αν η συσκευασία αποστέρωσης παραβιαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή έχει επικυρωθεί και πιστοποιημένο εργαστήριο.							



**PropGard™ / Tongue Guard**  
Manufactured by:  
Ultradent Products, Inc.  
505 West Ultradent Drive (10200 South)  
South Jordan, Utah 84095 USA  
Made in USA

**ULTRADENT PRODUCTS, INC.**  
8 0 0 . 5 5 2 . 5 5 1 2 | [ultradent.com](http://ultradent.com)  
© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 24617AR12 051220