

kidevo prime / prime.t.

Bon de commande.

Donneur d'ordre

Numéro de client _____

Nom _____

Rue, n° _____

CP, Ville _____

N° de série du fauteuil _____

Devis

Code de configuration en ligne _____



kidevo prime
L'illustration contient des options

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom _____

Rue, n° _____

CP, Ville _____

Com. _____

i Remarques

Cette bon de commande sert à l'adaptation et à la documentation. La demande d'offre officielle doit impérativement être effectuée via le configurateur en ligne afin de vérifier la constructibilité. Votre conseiller du service externe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.



kidevo prime.t
L'illustration contient des options

Prix : à partir de CHF 3'540.–

No. d'article 480A167=00000
Chiffre tarifaire 40.148.001

Équipement de base

- Châssis
- Plaque de siège
- Tube dorsal fixe + adaptateur
- Frein à pression
- Pneus à air ou PU
- Mains courantes, aluminium

Prix : à partir de CHF 3'910.–

No. d'article 480A167=10000
Chiffre tarifaire 40.148.003

Équipement de base

- Châssis
- Plaque de siège
- Tube dorsal fixe + adaptateur
- Inclinaison de l'assise par commande au pied
- Frein à pression
- Pneus à air ou PU
- Mains courantes, aluminium

Données techniques

- Charge max : 75 kg
- Largeur d'assise : 26 – 50 cm
- Profondeur d'assise : 20 – 50 cm
- Taille des roues motrices: 22, 24 und 26"

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

Données techniques


- Charge max : 75 kg
- Largeur d'assise : 28 – 50 cm
- Profondeur d'assise : 20 – 50 cm
- Inclinaison de l'assise : -10 bis +50°
- Taille des roues motrices : 22, 24 und 26"

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2025, hors 8.1% TVA

Nom _____ Date _____ Signature _____

Otto Bock (Suisse) SA · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16
T +41 41 455 61 71 · F +41 41 455 6 70 · suisse @ottobock.com · www.ottobock.ch

Information

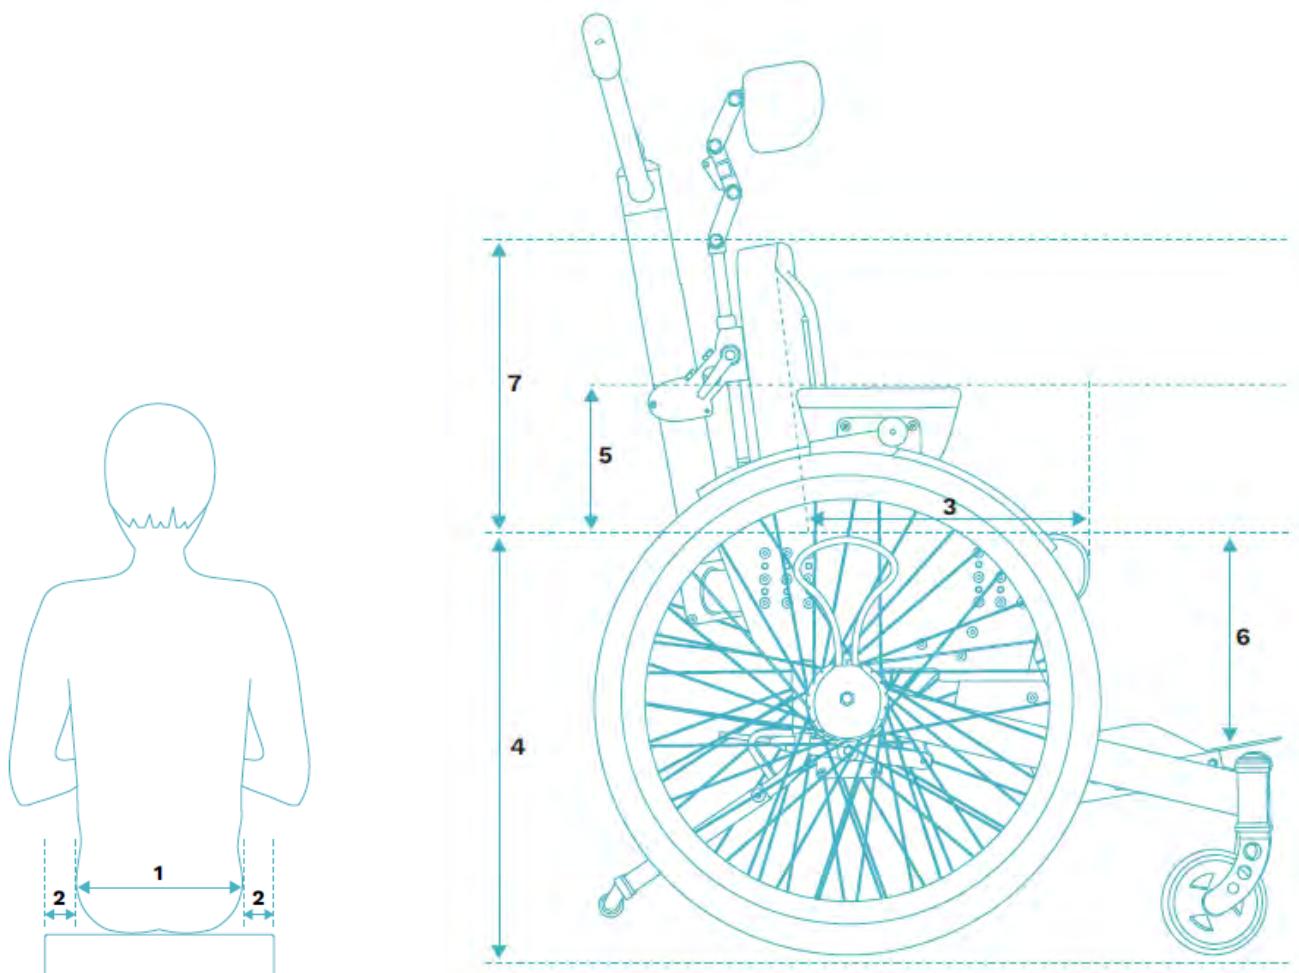

Dimensions du fauteuil roulant

1 Largeur des hanches (25 - 45 cm)	cm	5 Hauteur des accoudoirs	cm
2 Espace supplémentaire à côté de la hanche		<i>kidevo prime</i> (13 - 29 cm)	cm
0 cm 0,5 cm 1 cm 1,5 cm		<i>kidevo prime.t</i> (15 - 25 cm)	cm
3 Profondeur d'assise (ST) (20 - 50 cm)	cm	La hauteur des accoudoirs dépend de la hauteur de l'assise, voir configurateur	
4 Hauteur d'assise (SH) prime		6 Longueur réelle du tibia (16 - 50 cm)	cm
47 cm = 22" Roues motrices	50 cm = 22" Roues motrices		
50 cm = 24" Roues motrices	53 cm = 22" Roues motrices		
53 cm = 24" Roues motrices	53 cm = 26" Roues motrices		
56 cm = 24" Roues motrices	56 cm = 26" Roues motrices		
59 cm = 26" Roues motrices	62 cm = 26" Roues motrices		
4 Hauteur d'assise (SH) prime.t		7 Hauteur du dossier (21 - 50 cm)	cm
47 cm = 22" Roues motrices	49 cm = 24" Roues motrices		
50 cm = 22" Roues motrices	52 cm = 24" Roues motrices		
54 cm = 26" Roues motrices	57 cm = 26" Roues motrices		

Modèle

kidevo prime (sans bascule de l'assise)

kidevo prime.t (avec bascule de l'assise, -10° bis + 50°)

Commande bascule de l'assise pour kidevo prime.t

par pédale	accoudoirs fixes	basculement conjoint des accoudoirs	Blocage d'inclinaison au niveau de la pédale
------------	------------------	-------------------------------------	--

Centre de gravité

Standard	Actif	Passif
----------	-------	--------

Siège - voir croquis à partir de la page 6

Siège anatomique

Siège ergonomique, sur mesure

Siège au galbe profond

Siège-selle

Embase pour siège, sans mousse, sans housse

Housse du siège

Sans housse, uniquement mousse

Similicuir noir

Tissu d'espacement noir

Platilon noir

Ajustements siège - voir page 7

Outil de positionnement pour siège

Aucune ceinture

Ceinture 2 points rembourrée

Ceinture 4 points rembourrée

Baudrier modèle T, sangle fix ou flexible, div. fermetures, voir configateur

Baudrier modèle Y, sangle fix ou flexible, div. fermetures, voir configateur

Abduction (uniquement pour kidevo prime) - voir page 7

Sans cale ou rouleau d'abduction

Cale d'abduction

Rouleau d'abduction

Adduction - voir page 8

Sans support d'adduction

Supports d'adduction fixes

Supports d'adduction à largeur et inclinaison réglables

Pelote pelvienne

Sans pelotes pelviennes

Pelotes pelviennes Taille S Taille M

Accoudoirs

Standard, justable en hauteur

Rallongé, ajustable en hauteur

Support tablette thérapeutique avec sans

Poignées de transfert oui non

Unité de dossier

Tube de dossier standard, fix amovible

Tube de dossier 10°, amovible

Tube de dossier à ressorts, amovible

Tube dossier à inclinaison régl. (30°), amovible

Barre de poussée: inclinaison réglable rigide

Dossier -voir croquis à partir de la page 8

Sans dossier			
Dossier monobloc			
Dossier monobloc avec pelotes latérales			
Dossier au galbe profond			
Dossier 2 parties avec pelotes PU	Taille XS	Taille S	Taille M
Pelotes latérales fixes PU			uniquem. pour dossier monobloc voir le configurateur pour plus de détails
Pelotes latérales pivotantes PU		Taille S	Taille M
			uniquem. pour dossier monobloc voir le configurateur pour plus de détails

Outil de positionnement pour dossier

Aucune ceinture de positionnement			
Sangle d'épaule			
Sangle thoracique et d'épaule			
Sangle sternale			
Espaceur pour sangles			

Appuie-tête

Sans appuie-tête			
Modèle standard			
Modèle coudé	Taille S	Taille L	
Modèle anatomique			
Modèle latéral			
Uniquement support d'appuie-tête			
Système de protraction			

Repose pieds

Repose-pieds relevables:	Palettes séparées	Palette monobloc (uniquement pour <i>kidevo prime.t</i>)	
Palette monobloc standard	fix	relevable	Plaque mollet avec guidage latéral avec dispositif de blocage, fixable
Palette monobloc à ressorts	fix	relevable	
Bordure talonnière:	oui	non	
Ajustements palette:	Palette avec protection périphérique Rehausse de palette	Roulettes déflectrices au niveau des angles de palette Double suspension de palette	
Rembourrage palette:	Uniquement palette	Uniquement bordure talonnière	Palette et bordure talonnière
Fixation de pied et de cheville:	sans	Fixation de pied	Fixation de cheville
Plaque pour mollet:	sans	Plaque pour mollet	Plaque mollet avec guidage latéral

Roues motrices

Standard			
Entraînement à 1 main			
Côté entraînement:	droit	gauche	
Distance entre les courant mains:	10 mm	15 mm	20 mm 25 mm variable selon taille de la roue
Roues électrique:	Kit de fixation pour Alber E-motion Kit de fixation pour Decon E-Drive	Kit de fixation pour Alber E-Fix Kit de fixation pour Decon E-Move	
Carrossage	3°	7°	

Pneus

Pneu à air			
Pneus en PU (caoutchouc plein)			
Pneus Outdoor			

Mains courantes

- Monter les mains courantes Ergo Grip sur les 2 roues motrices
- Monter les mains courantes Ergo Grip sur la roue motrice non entraînée
- Mains courantes en aluminium sur roue motrice non entraînée
- 6 boules pour main courante montées sur main courante, extérieure (grande)
- Monter 6 boules pour main courante sur main courante (petite) intérieure
- Mains courantes en aluminium avec revêtement

Freins

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| Frein à tambour, commandé par: | uniquement l'enfant | uniquement les parents | l'enfant et les parents |
| Frein à tambour fix sur le châssis | | | |
| Frein à tambour démontable | | | |
| Freins à pression | | | |

Flasques

- | | | | |
|---|--|--|--|
| Sans | | | |
| Transparent | | | |
| Protège-rayons avec image à choix (voir catalogue des flasques/configurateur) | | | |

Bord protège-vêtements et revêtement de roue

- | | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Sans | | | |
| Bord protège-vêtements | | | |
| Revêtement de roue | | | |


Accessoires

- | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------|--------|
| Tablette thérapeutique | oui | non | | |
| Tablette thérapeutique: | enfichable horizontalement | | | |
| Tablette thérapeutique: | enfichable horizontalement, rabattable latéralement vers | | droit | gauche |
| Set de transport TPMR | oui | non | | |
| Ajustements de roue directrice: | Roulettes déflectrices sur les têtes de commande des roues directrices
Stabilisation roue directrice | | | |
| Direction assistée | oui | non | | |
| Côté de montage | droit | gauche | | |
| Distance entre le dos et la poignée: | cm (10 - 30 cm) | | | |
| Distance entre l'assise et la poignée : | cm (5 - 40 cm) | | | |
| Anti-bascule | Standard | renforcé, roue skater 3" | | |
| Toit pare-soleil: | oui | non | | |
| Mud Cruiser (roue déportée ext.) | oui | non | | |

Couleur du châssis

Jaune soufre RAL 1016	mat	brillant	Vert turquoise RAL 6016	brillant
Jaune zinc RAL 1018	mat	brillant	Vert jaune RAL 6018	mat brillant
Jaune melon RAL 1028	mat	brillant	Blanc signalisation RAL 9016	brillant
Orange pur RAL 2004	matt		Gris foncé RAL 9023	brillant
Rose clair RAL 3015	mat	brillant	Gris ardoise RAL 7015	mat
Rouge signalisation RAL 3020	mat	brillant	Gris clair RAL 7035	mat
Lilas bleu RAL 4005	brillant		Noir intense RAL 9005	mat brillant
Violet de sécurité RAL 4008	brillant			
Telemagenta RAL 4010	brillant			
Bleu saphir RAL 5003	mat			
Bleu ciel RAL 5015	brillant			
Bleu turquoise RAL 5018	brillant			
Bleu de sécurité RAL 5005	mat			
Bleu pastel RAL 5024	mat			

Siège anatomique



Housse Tissu d'espacement

Profondeur totale (Zd): cm


Housse Similicuir

Profondeur totale (Zd): cm

Housse Platilon

Profondeur totale (Zd): cm

Siège ergonomique

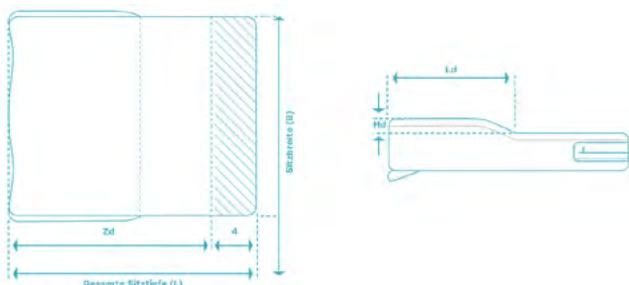

Housse Tissu d'espacement

Profondeur totale (Zd): cm Longueur de rehausse (Ld): cm Hauteur de rehausse (Hd): cm


Housse Similicuir

Profondeur totale (Zd): cm Longueur de rehausse (Ld): cm Hauteur de rehausse (Hd): cm

Housse Platilon

Profondeur totale (Zd): cm Longueur de rehausse (Ld): cm Hauteur de rehausse (Hd): cm

Siège au galbe profond

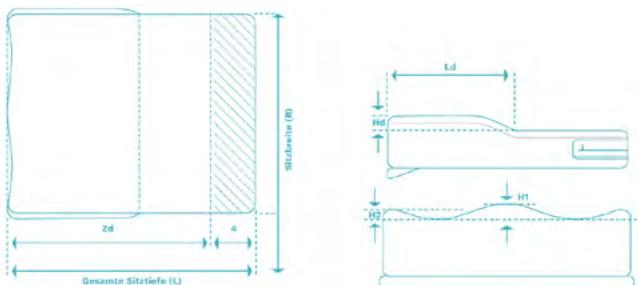

Housse Tissu d'espacement

Profondeur totale (Zd): cm Longueur de rehausse (Ld): cm Hauteur de rehausse (Hd): cm
Hauteur de la partie d'abduction (H1): cm Hauteur du galbe latéral (H2): cm


Housse Similicuir

Profondeur totale (Zd): cm Longueur de rehausse (Ld): cm Hauteur de rehausse (Hd): cm
Hauteur de la partie d'abduction (H1): cm Hauteur du galbe latéral (H2): cm

Housse Platilon

Profondeur totale (Zd): cm Longueur de rehausse (Ld): cm Hauteur de rehausse (Hd): cm
Hauteur de la partie d'abduction (H1): cm Hauteur du galbe latéral (H2): cm

Siège selle

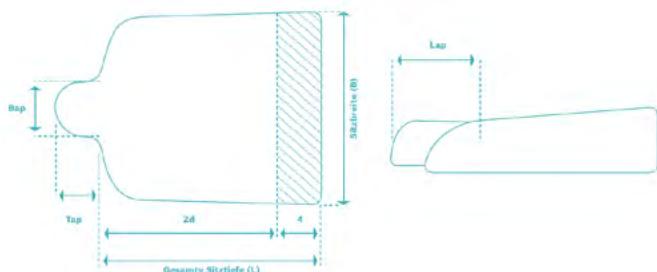

Housse Tissu d'espacement

Profondeur (Zd): cm Longueur de la partie d'abduction (Lap): cm

Longueur de la partie d'abduction à partir de la face avant du siège (Tap): cm

Largeur de la partie d'abduction (Bap): cm

Housse Similicuir

Profondeur (Zd): cm Longueur de la partie d'abduction (Lap): cm

Longueur de la partie d'abduction à partir de la face avant du siège (Tap): cm

Largeur de la partie d'abduction (Bap): cm

Housse Platilon

Profondeur (Zd): cm Longueur de la partie d'abduction (Lap): cm

Longueur de la partie d'abduction à partir de la face avant du siège (Tap): cm

Largeur de la partie d'abductions (Bap): cm

Ajustements siège (par rapport au siège sélectionné ci-dessus)

Housse additionnel en tissu éponge

Housse additionnel en Platilon

Housse additionnel en tissu d'espacement

Différentes longueurs de cuisse:


Longueur de cuisse gauche: cm Longueur de cuisse droite: cm

Rembourrage latéral: Longueur du rembourrage cm Hauteur du rembourrage cm
(Fabrication sur mesure) Épaisseur rembourrage, avant cm Épaisseur rembourrage, arrière cm

Siège avec revêtement en mousse à mémoire de forme

Couche intermédiaire suppl. (mousse dure PE)

Rouleau et cale d'abduction

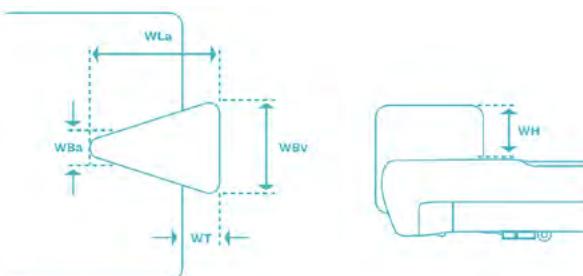

Housse (uniquement pour cale d'abduction)


tissu d'espacement

similicuir

Taille (cale d'abduction / rouleau d'abduction)

WLa: cm WBa: cm WBv: cm WT: cm WH: cm


Support d'adduction *kidevo prime*

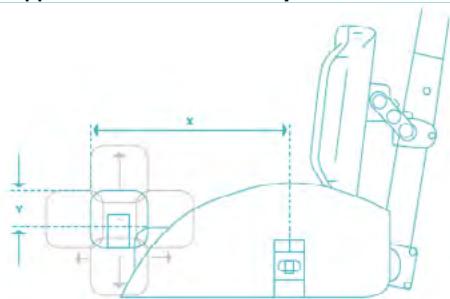

Profondeur X (Distance entre l'avant des supports et le dossier): cm (21 - 61 cm)

Hauteur Y (Distance bord supérieur de la pelote par rapport au siège): cm (4 - 12 cm)


Support d'adduction *kidevo prime.t*

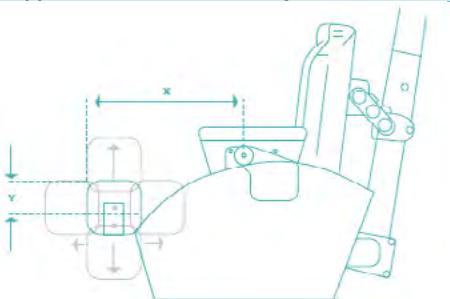

Profondeur X (Distance entre l'avant des supports et le dossier): cm

Hauteur Y (Distance bord supérieur de la pelote par rapport au siège): cm

Dossier monobloc

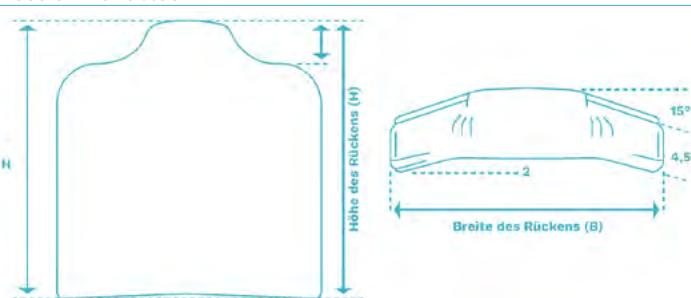

Housse Tissu d'espacement

Hauteur du dossier complet (H): cm Hauteur de l'évidement pour les épaules (Y): cm

Largeur de la face intérieure du dossier (B): cm Profondeur de la face intérieure du dossier (Dpr): cm

Housse Similicuir

Hauteur du dossier complets (H): cm Hauteur de l'évidement pour les épaules (Y): cm


Largeur de la face intérieure du dossier (B): cm Profondeur de la face intérieure du dossier (Dpr): cm

Housse Platilon

Hauteur du dossier complets (H): cm Hauteur de l'évidement pour les épaules (Y): cm

Largeur de la face intérieure du dossier (B): cm Profondeur de la face intérieure du dossier (Dpr): cm

Dossier monobloc avec pelotes latérales

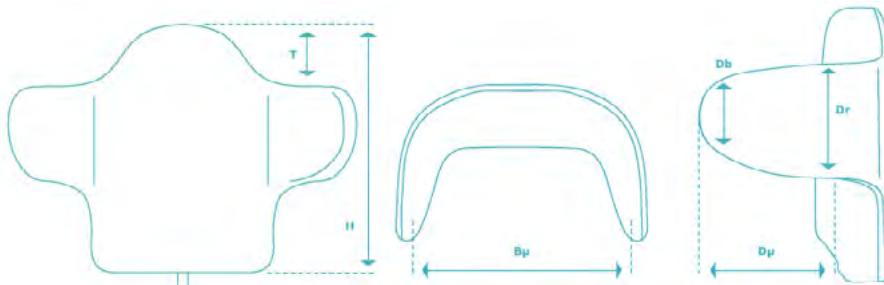

Housse Tissu d'espacement

Hauteur du dossier complet (H): cm Hauteur de l'évidement pour les épaules (T): cm
 Écart entre les pelotes (Bp): cm Profondeur des pelotes (Dp): cm
 Profondeur des pelotes; max. H – T (Dr): cm
 Hauteur de la pelote côté poitrine; max. Dr – 4 (Db): cm


Housse Similicuir

Hauteur du dossier complets (H): cm Hauteur de l'évidement pour les épaules (T): cm
 Écart entre les pelotes (Bp): cm Profondeur des pelotes (Dp): cm
 Profondeur des pelotes; max. H – T (Dr): cm
 Hauteur de la pelote côté poitrine; max. Dr – 4 (Db): cm

Housse Platilon

Hauteur du dossier complets (H): cm Hauteur de l'évidement pour les épaules (T): cm
 Écart entre les pelotes (Bp): cm Profondeur des pelotes (Dp): cm
 Profondeur des pelotes; max. H – T (Dr): cm
 Hauteur de la pelote côté poitrine; max. Dr – 4 (Db): cm

Dossier au galbe profond

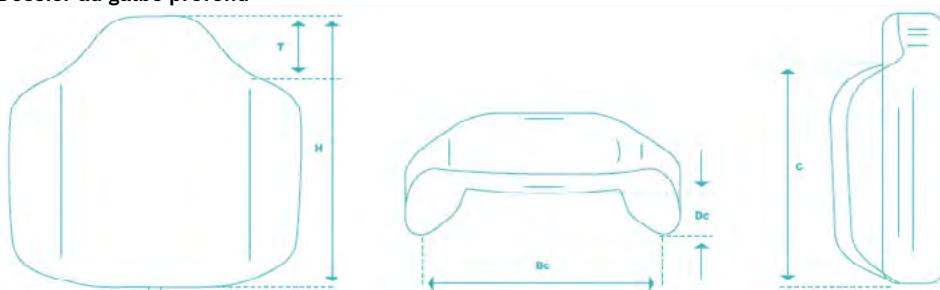

Housse Tissu d'espacement

Hauteur du dossier complet (H): cm Hauteur de l'évidement pour les épaules (T): cm
 Largeur de la face intérieure du galbe de dossier (Bc): cm Profondeur de la face intérieure du galbe de dossier (Dc): cm
 Hauteur du galbe de dossier; max. H – T (C): cm

Housse Similicuir

Hauteur du dossier complete (H): cm Hauteur de l'évidement pour les épaules (T): cm
 Largeur de la face intérieure du galbe de dossier (Bc): cm Profondeur de la face intérieure du galbe de dossier (Dc): cm
 Hauteur du galbe de dossier; max. H – T (C): cm

Housse Platilon

Hauteur du dossier complet (H): cm Hauteur de l'évidement pour les épaules (T): cm
 Largeur de la face intérieure du galbe de dossier (Bc): cm Profondeur de la face intérieure du galbe de dossier (Dc): cm
 Hauteur du galbe de dossier; max. H – T (C): cm

Notes / Croquis