

クイック調整ガイド

ProCarve スキー・スノーボード用義足

－ 製作技術者向け －




1. 安全に関する注意事項

初めて使用する際は、義肢装具士または、スキーおよびスノーボードのインストラクターと一緒に行ってください。

			
最低運動時間	ロック解除	ロック	注意

2. システム概要

- ① 755Y68 ② 4WR95=1 ③ 4WR95=2 ④ 4R77 ⑤ 4R54 ⑥ 4G115
⑦ 3R2 ⑧ 4WR95=3 ⑨ 2WR95 ⑩ 4R72=* ⑪ 1E2 ⑫ 1E2=1 ⑬ 4G901

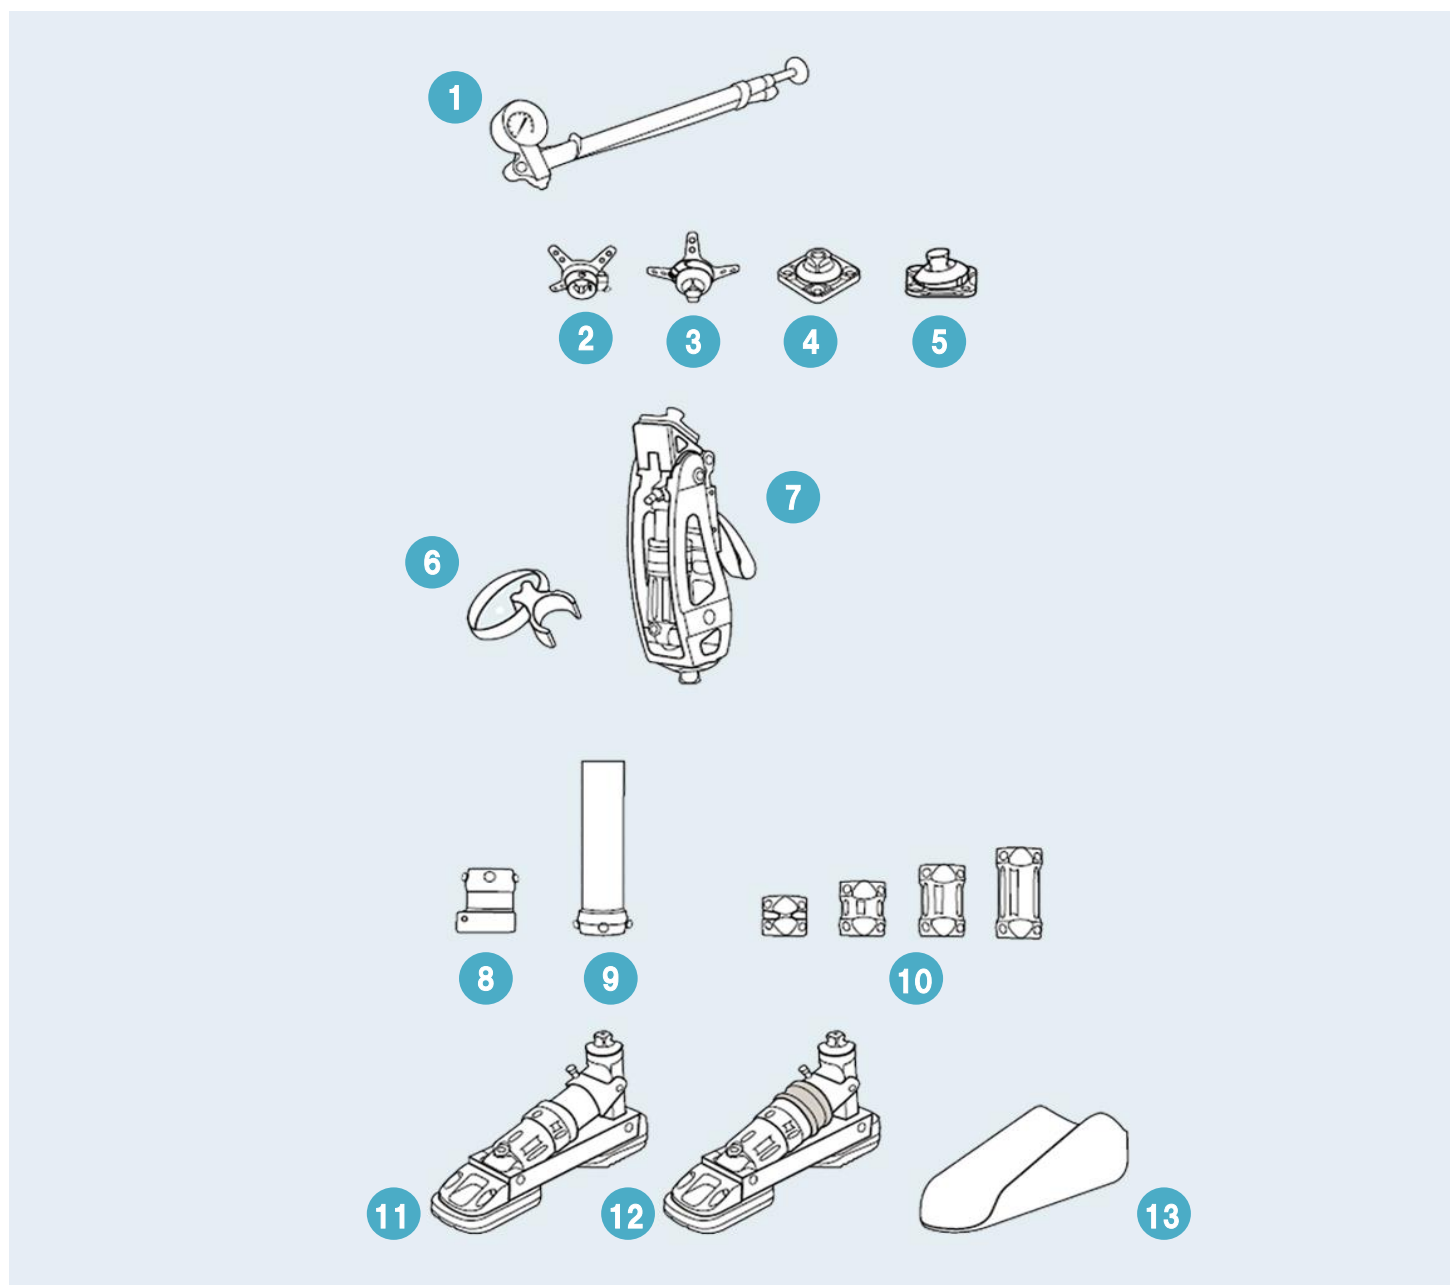

3. フィッティング 10ステップ


- 3-1. スキービンディングとフットカバーへの装着
- 3-2. スキーおよびスノーボード使用時のアライメント
- 3-3. 屈曲抵抗の調整
- 3-4. 伸展抵抗の調整
- 3-5. ロック解除方法
- 3-6. スキービンディングへの取付け
- 3-7. スキーのエクササイズ
- 3-8. エクササイズ - ロック解除
- 3-9. アライメント調整
- 3-10. プロカーヴでの歩行時

3-1. スキービンディングとフットカバーへの装着

1) スキービンディングへの装着

スキーのビンディング中央にプロカーヴフットを装着してください。

 ビンディング解放値の設定は、体重からマイナス10kgした数値を基準にしてください。

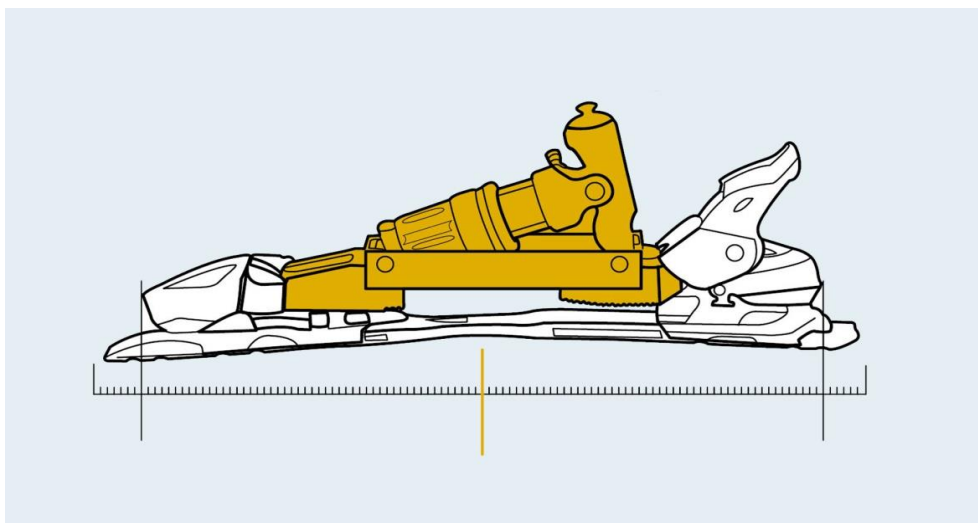


2) フットカバーへの装着


フットパッド（スキービンディング装着パーツ）を取外します。

フットカバーを装着し、ロックタイトを塗布し10Nmでネジを締めます。

直接スノーブーツを履く事ができます。

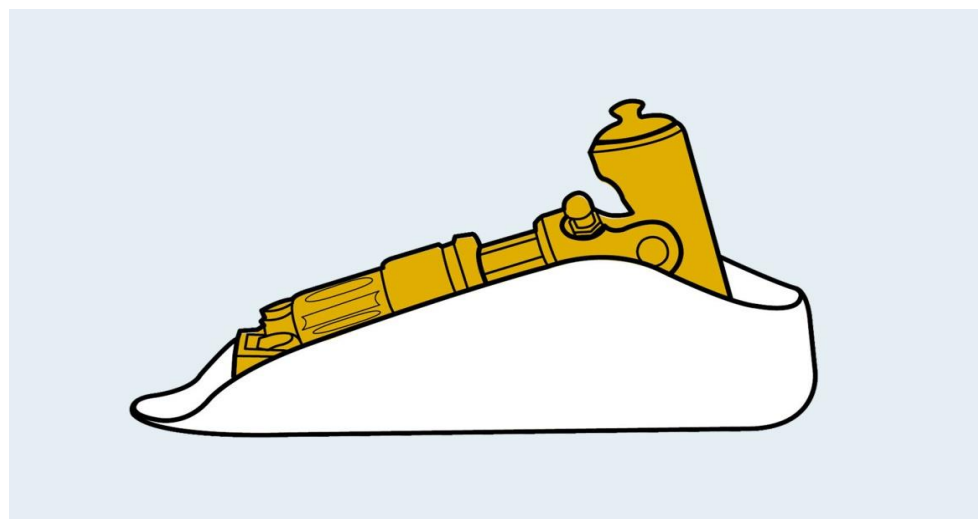



3-2. スキーおよびスノーボード使用時のアライメント

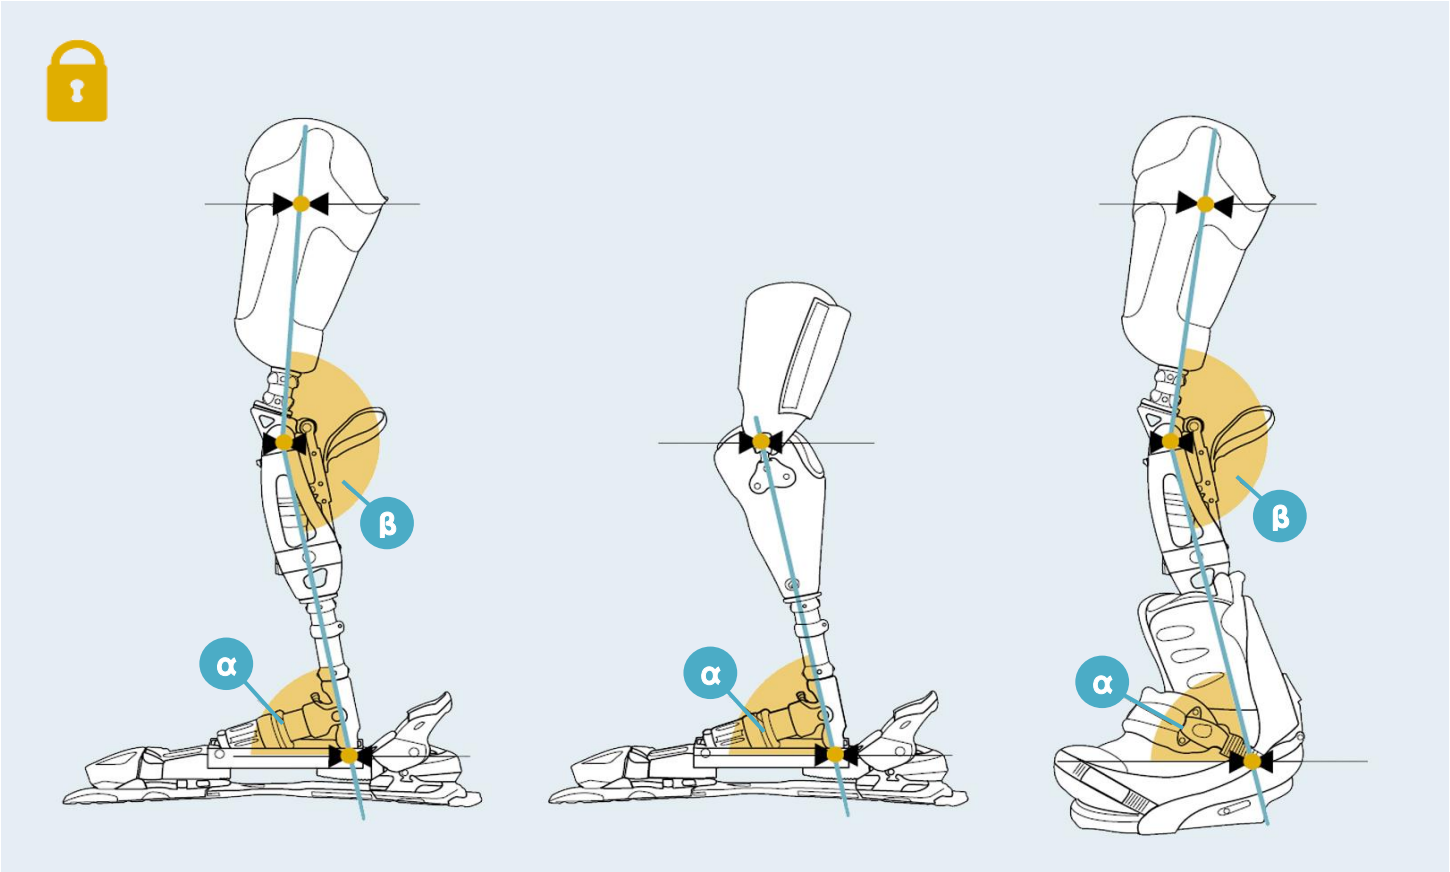

下記表は一般的な推奨値です。ユーザー個々に合わせて調整してください。

	75° - 85°		120° - 160°
	80° - 90°		120° - 160°
	75° - 80°		120° - 160°
	80° - 85°		

3-3. 屈曲抵抗の調整

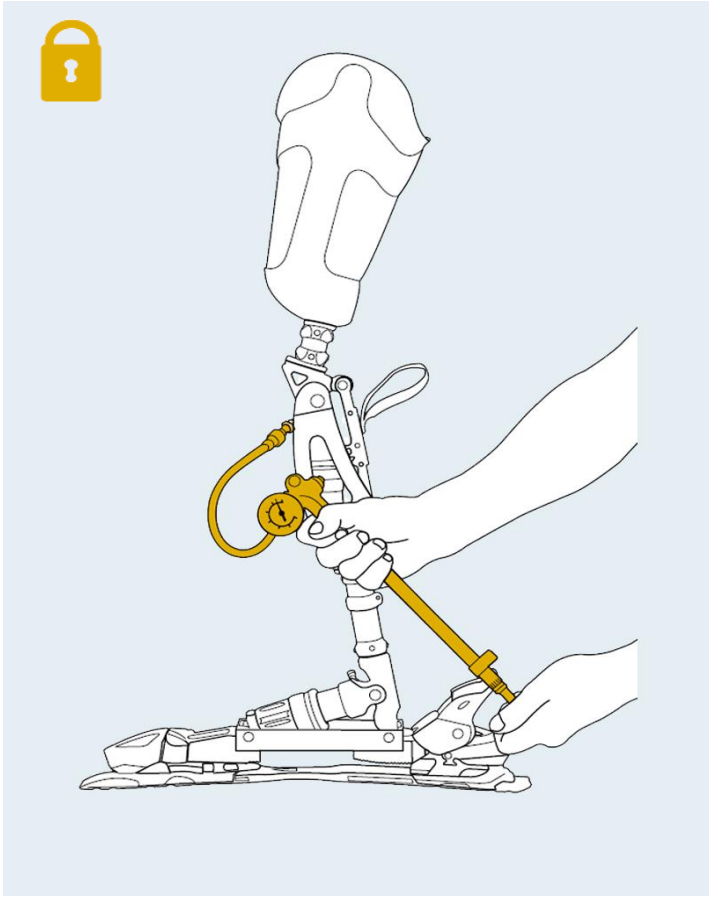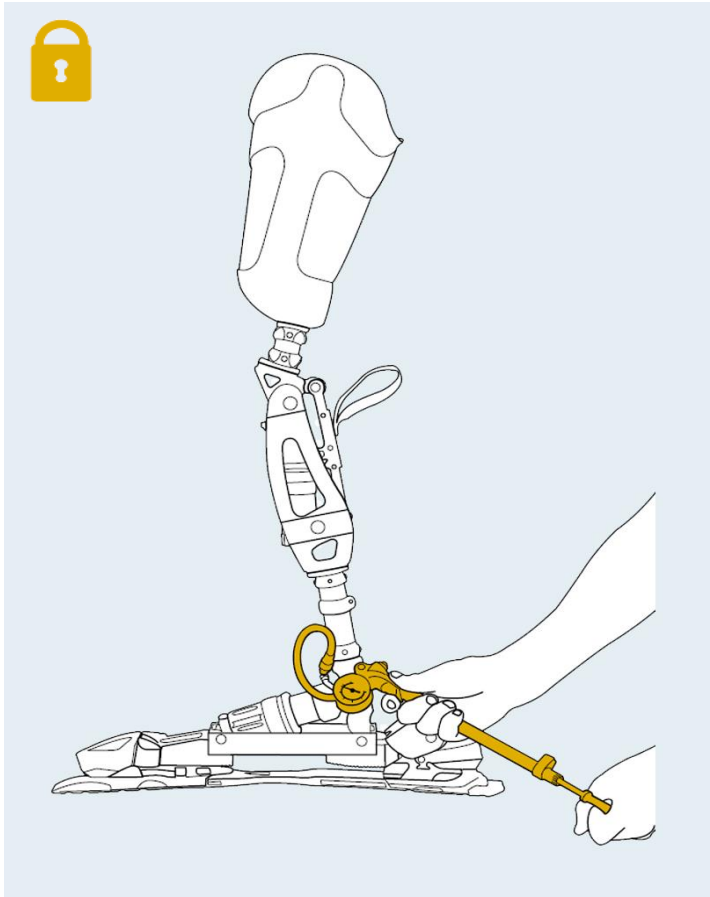



下記表は一般的な推奨値です。ユーザー個々に合わせて調整してください。

		 bar
		8 - 15
		15 - 25
		5 - 15
		20 - 25

	 bar
	8 - 15
	8 - 15

3-4. 伸展抵抗の調整



時計回りに回すと抵抗が強くなり、伸展の動きがゆっくりになります。

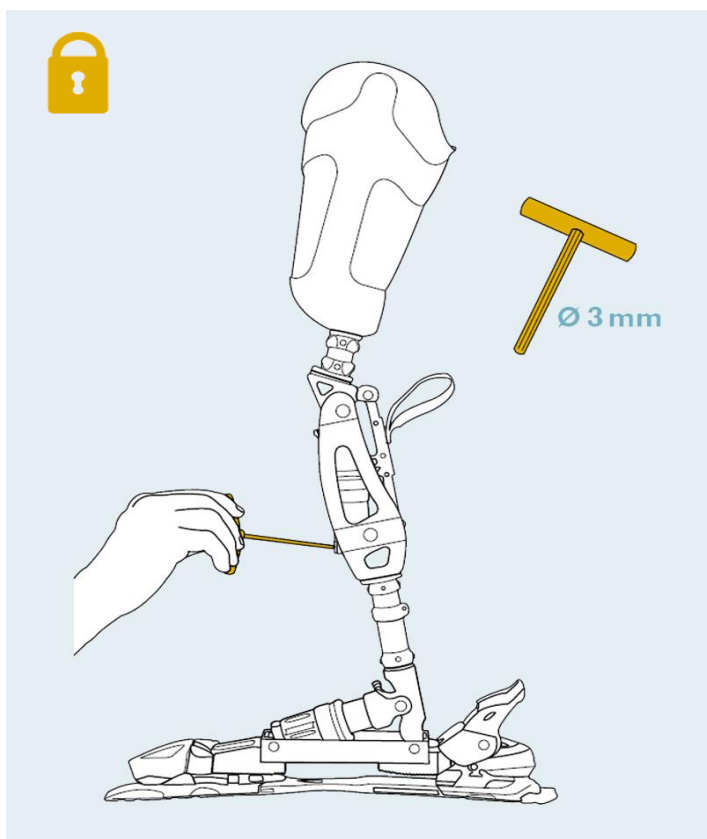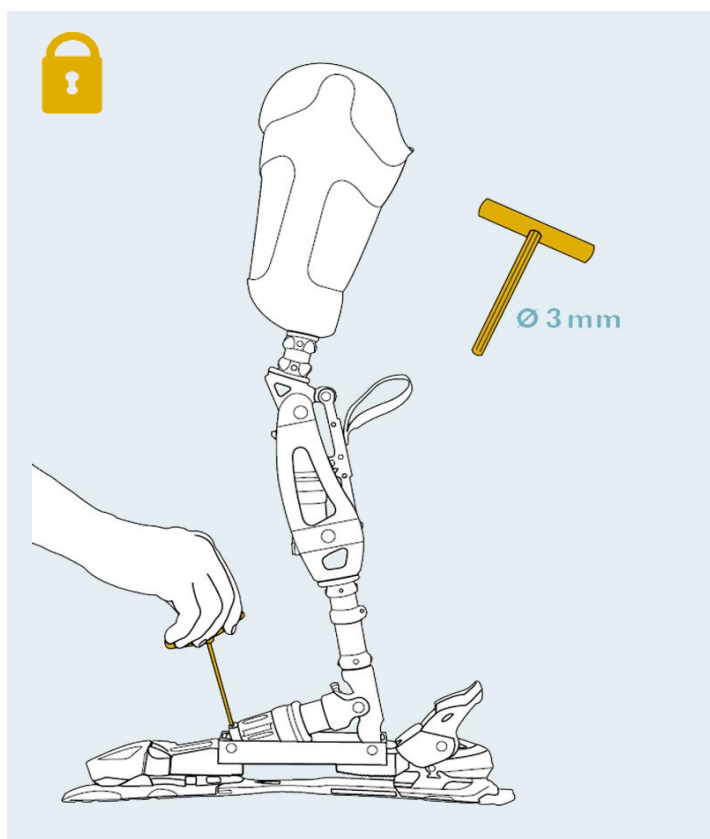

3-5. ロック解除方法


膝継手後方のストラップを上方に引く事で、ロック解除が可能です。

 再度ロックする際は、確実にロックされている事を確認してください。

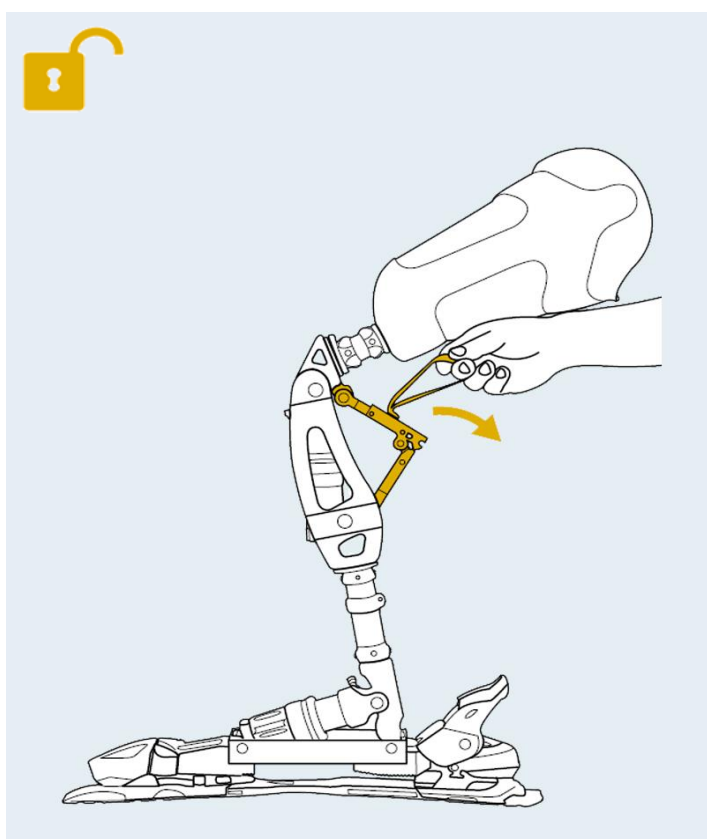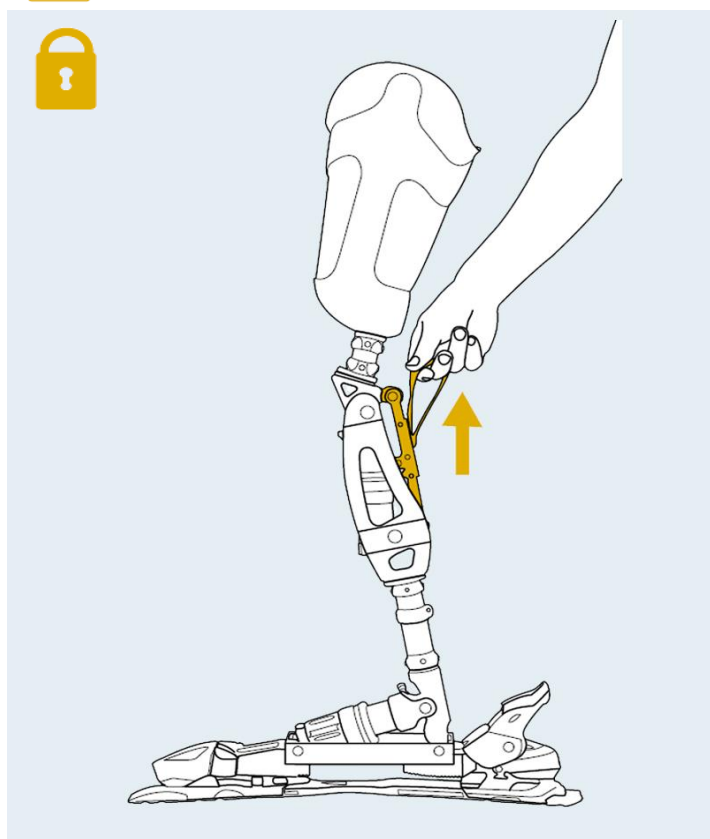

3-6. スキービンディングへの取付け


まずプロカーヴ側を取付け、その後に反対側を取付けます。

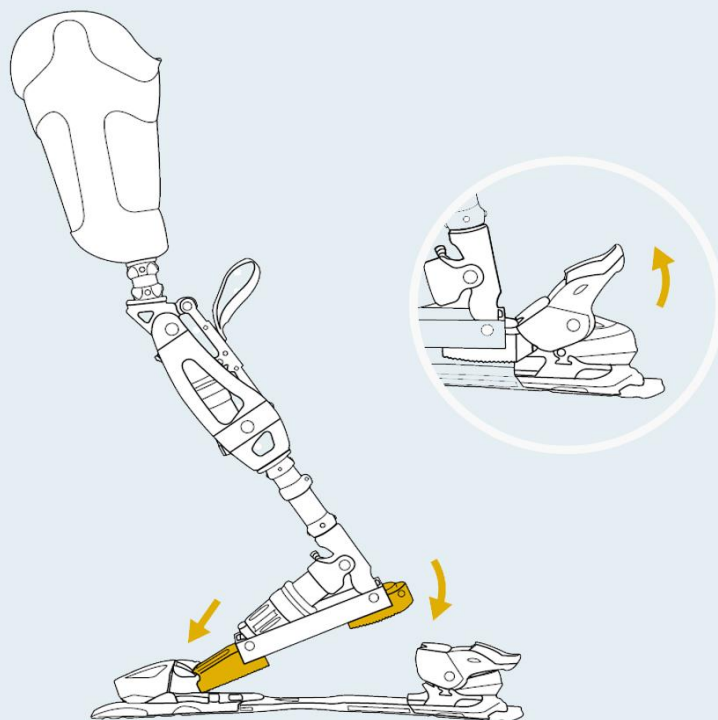


3-7. スキーのエクササイズ

義足に慣れるまで小さくその場でステップを踏みます。

この時、スキー板が並行であることを確認します。必要に応じて調整を行ってください。

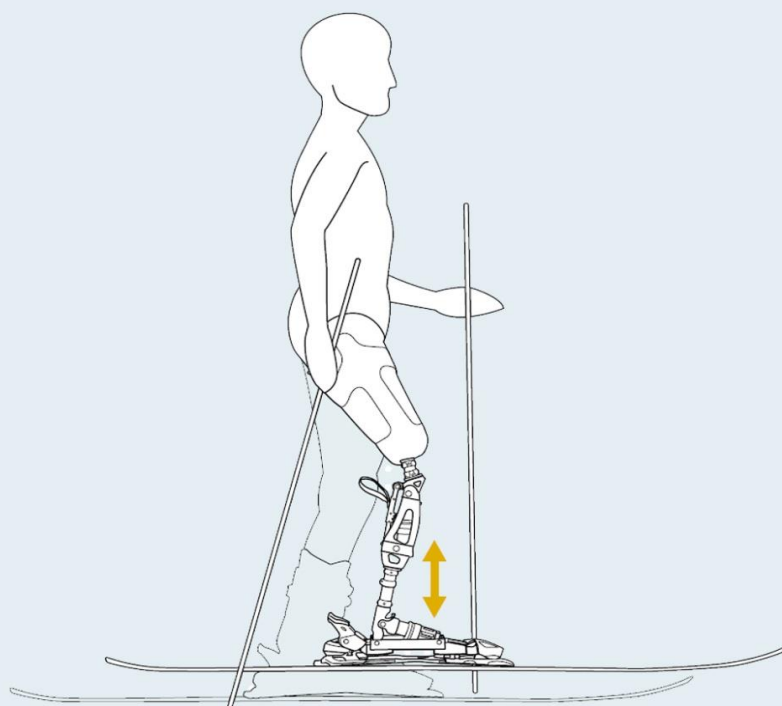



スキーを前後に、交互に滑らせます。

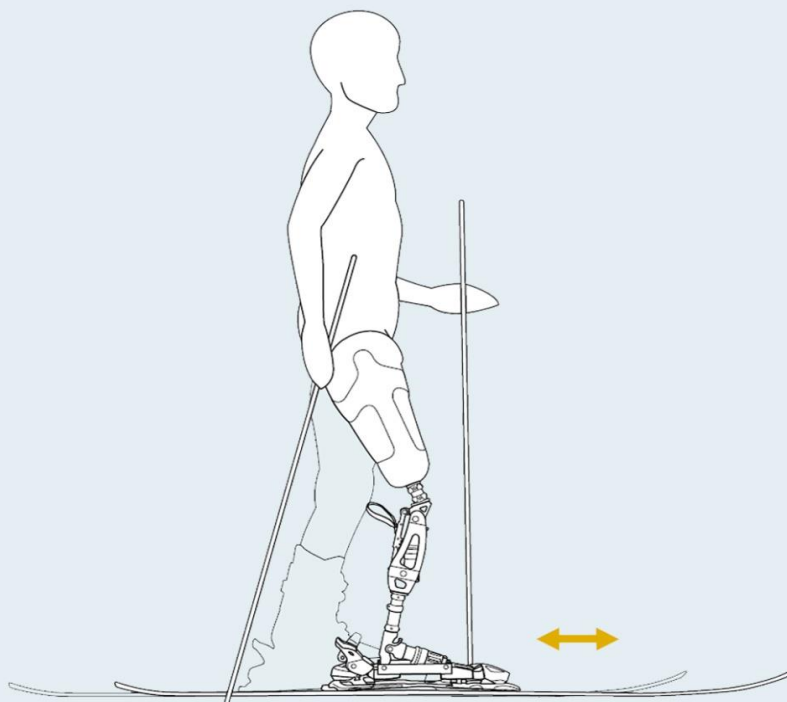

3-8. エクササイズ – ロック解除


リフトに乗る際、ストラップを上方に引いてロックを解除します。

 再度ロックする際は、確実にロックされている事を確認してください。

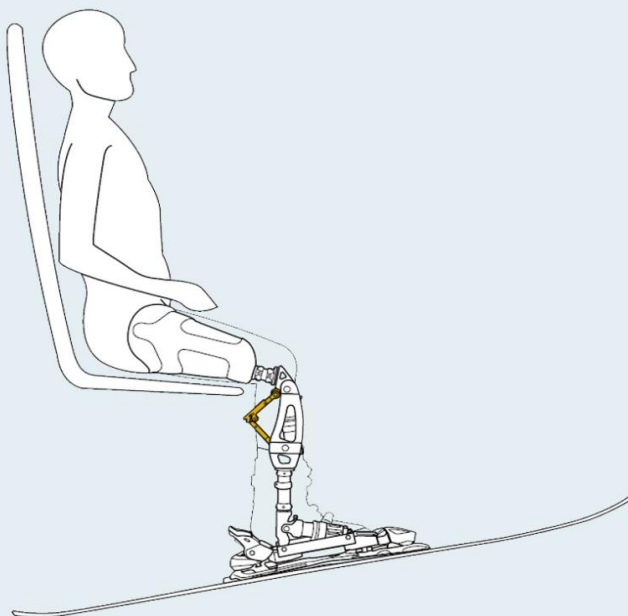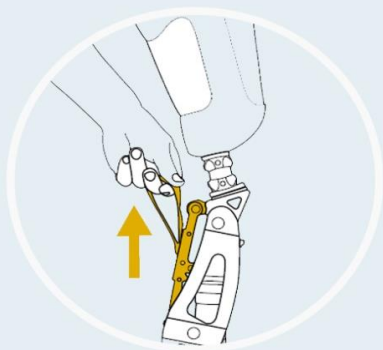



3-9. アライメント調整

エクササイズ後、再度アライメントの確認を行います。
重心がビンディングの中央にある事を確認します。

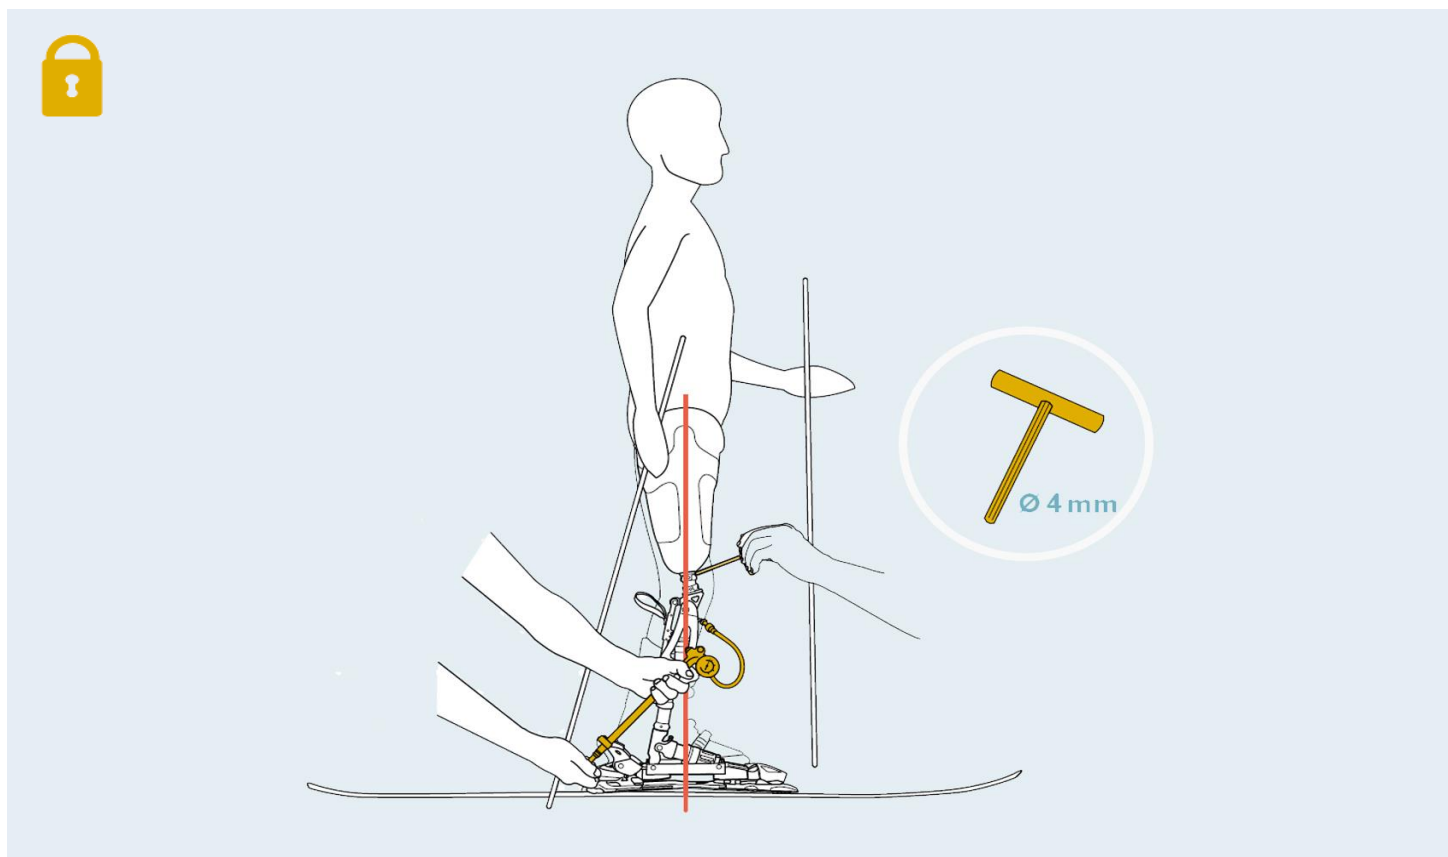

3-10. プロカーヴでの歩行時

膝継手のシリンダーを付属のクリップで挟む事で、膝継手が屈曲せず安全に歩行する事ができます。

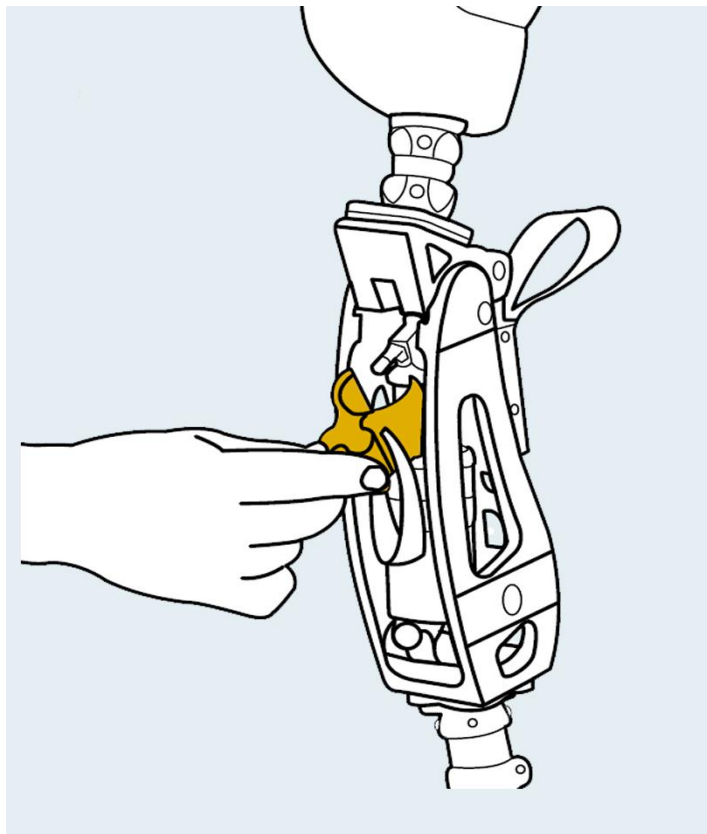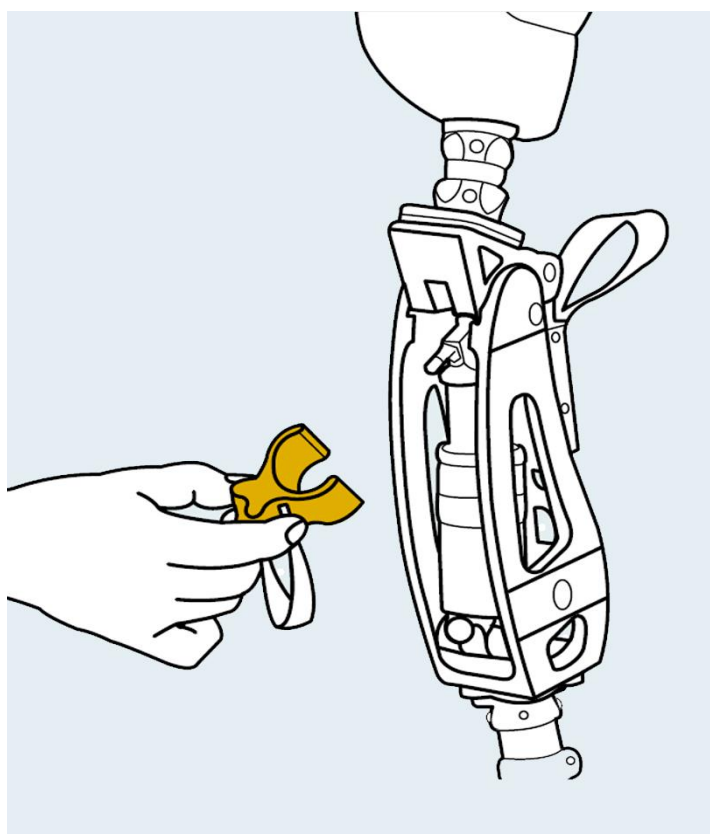

ottobock.

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載する事を禁止します。

オットーボック・ジャパン 株式会社
<https://www.ottobock.com/ja-jp/>

義足調整マニュアル



義足の調整マニュアル
https://www.ottobock.com/ja-jp/technical/prosthetic_le/adjustment