Installationshandbuch Spender für Desinfektionsspender Säule

DIESER POLE IST NICHT FÜR GEL ODER SEIFE GEEIGNET, NUR FÜR FLÜSSIGKEIT. DIES IST EIN WASSERAHNLICHER STOFF!

TEILE NICHT ENTFERNEN, ALLE TEILE SIND FÜR DIE FUNKTION DES SPENDERS ERFORDERLICH .

!!! Es ist wichtig, dass Sie den Spender in Bild A überprüfen und installieren, bevor Sie die gesamte Säule zusammenbauen und diesen Spender darauf montieren !!!

- Öffnen Sie den Spender mit dem weißen Quadrat an der Unterseite des Spenders.
- Sobald Sie es geöffnet haben, sehen Sie das Innere in Bild B. Hier sind 3 rot eingekreiste Teile, die weiter unten erläutert werden.
    - Die Batteriekassette sollte wie in Abbildung C gezeigt auf der linken Seite platziert werden. BITTE BEACHTEN SIE, DASS ALLE BATTERIEN RICHTIG EINGEFÜGT SIND, damit die BATTERIEN GUT KONTAKTIEREN.
    - In der Mitte sehen Sie einen transparenten Teil, der rot eingekreist ist. Dies ist der Pumpmechanismus, der sich auf und ab bewegt und die Dosierung der Flüssigkeit sicherstellt. Es ist sehr wichtig, dass der weiße Ring in Bild D genau rot dargestellt und eingekreist ist in den 2 transparenten Schlitzen. Diese Schlitze befinden sich am unteren Rand des transparenten Teils und sind zusätzlich wieder rot eingekreist.
    - Auf der rechten Seite finden Sie die Schaltfläche zum Einstellen der Dosis. Position 1 ist ausreichend, aber falls gewünscht, pumpt das Gerät an den anderen Positionen zwei- oder dreimal hintereinander.

Abbildung A.

Abbildung B.

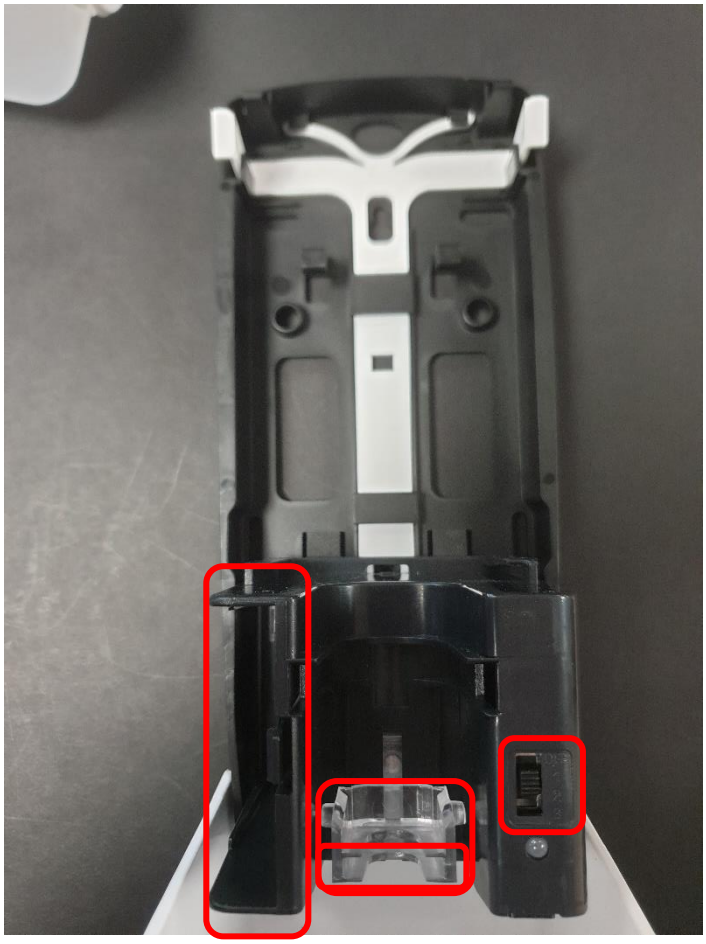

Abbildung C.

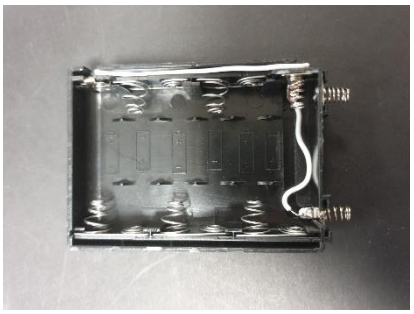

Überprüfen Sie das in Abbildung D gezeigte Innere (Nachfüllflasche), um mögliche Undichtigkeiten zu vermeiden. ENTFERNEN Sie vor dem Gebrauch NICHT DIE ROTE TASTE !!

- Stellen Sie sicher, dass das Fläschchen richtig mit dem Hals der Pumpenkappe verbunden ist. (das obere rote Kreisbild D)
- Ziehen Sie den Rippenring bei Bedarf fest. Fest ist behoben! (mittleres rotes Kreisbild D)
- Bitte drücken Sie das Pumpenteil manuell, bis Sie ein Klicken hören. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, den weißen Ring (unteres Kreisbild D) mit Ihren Fingern zu drücken.

Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, setzen Sie die Flasche wieder in die Patrone ein.
Abbildung E zeigt, wie es richtig platziert ist.
Schließen Sie danach die Haube und prüfen Sie, ob der Spender ordnungsgemäß funktioniert. Sie tun dies, indem Sie Ihre Hand vorsichtig von vorne unter den Spender halten. **Denken Sie daran, dass der Sensor Zeit braucht, um zu reagieren**, und dass Sie Ihre Hand nicht sehr schnell darunter bekommen. Sie können hören, wie sich der Mechanismus dreht, und wenn er gepumpt hat, können Sie Ihre Hand wieder darunter halten. Sie müssen den Spender dafür nicht füllen!

Abbildung D.

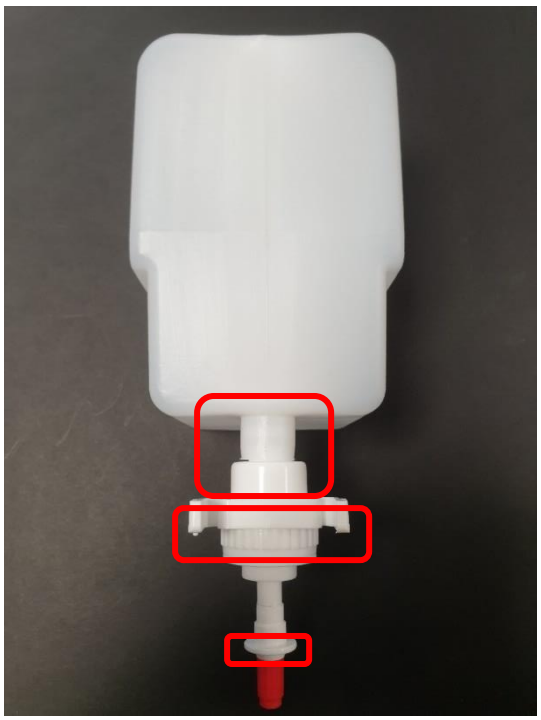

Abbildung E.

In einigen Fällen kann Licht oder Lichtreflexion zu Fehlfunktionen des Sensors führen. Es gibt eine Reihe von Optionen, um dies zu lösen.
• Bewegen / drehen Sie den Spender, um den Lichteinfall zu ändern und Reflexionen zu vermeiden.
• Bringen Sie den mitgelieferten mattschwarzen Aufkleber in der Tropfschale an, um Reflexionen zu vermeiden.
• Indem Sie die Platte der Tropfschale einige mm nach unten biegen, ändern Sie den Reflexionswinkel, damit Fehlfunktionen vermieden werden.

Abbildung F.

Magnet in der Haube vorhanden? (Siehe Abbildung F)

Befindet sich an der Innenseite der weißen Kappe kein Magnet, wird die nicht funktionieren Spender. Überprüfen Sie, ob es bei Ihrem Spender vorhanden ist funktioniert nicht sofort nach der Installation.