Prosimy przestrzegać zaleceń producenta



MELAG
competence in hygiene


Nowa MELA*store* Tray

dla okulistyki

Aby zapewnić optymalny proces higieniczny dla złożonych zestawów do operacji zaćmy, MELA*store* Tray Ophthalmology składa się z kosza górnego i dolnego: Kosz górny tacy myjącej z elastycznie pozycjonowanymi silikonowymi elementami służy do bezpiecznego mocowania zarówno instrumentów sztywnych, jak i przegubowych. Kosz dolny jest wyposażony w szynę iniekcyjną i uniwersalne przyłącza zapewniające niezawodne czyszczenie i dezynfekcję instrumentów kanałowych.

Wszystkie ważne informacje dotyczące konfiguracji i załadunku MELA*store* Tray Ophthalmology znajdziesz w poniższym przewodniku po produkcie:

1.

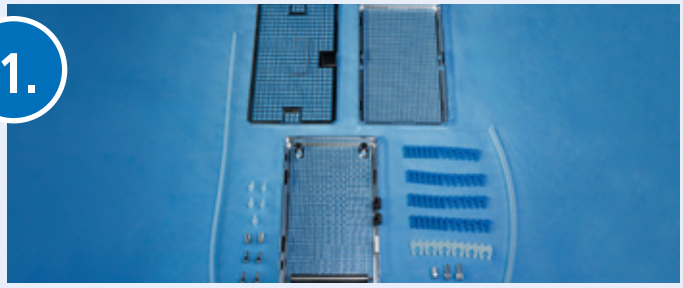


MELA*store* Tray jest dostarczana ze wszystkimi elementami potrzebnymi do załadunku i podłączania standardowych zestawów do operacji zaćmy. Jeśli potrzebne są dodatkowe silikonowe elementy, można je domówić pod nr art. ME82970 (opakowanie 2 szt.).

Szyna iniekcyjna zamontowana w tacy myjącej ma 6 przyłączy do instrumentów kanałowych. Jeśli potrzebna jest mniejsza liczba przyłączy (np. w przypadku stosowania jednorazowych kaniul irygacyjnych), niewykorzystane wyjścia należy zamknąć śrubami zaślepiającymi (Nr art. ME80140).

2.






Aby skonfigurować przyłącza przewodów dla rękojeści fako oraz rękojeści ssącej i irygacyjnej, dostarczony cieńszy przewód należy przyciąć zgodnie z ilustracją w kroku 4.

Łącznie potrzebne są cztery przewody przycięte na wymiar: na jednym końcu przewodu montuje się przyłącze ze stali nierdzewnej, a na drugim plastikowe adaptery Luer – męski i żeński.
Przyłącze ze stali nierdzewnej podłącza się do szyny iniekcyjnej w tacy myjącej, a plastikowe adaptery do instrumentów.

3.

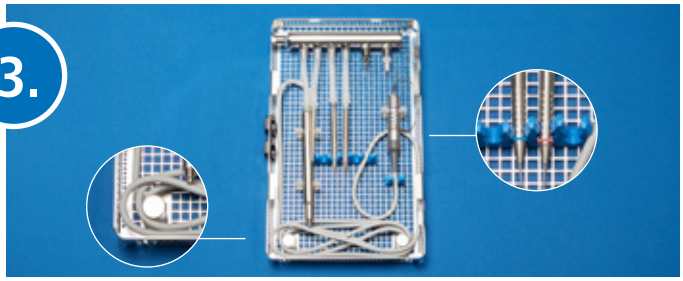

Teraz podłącz instrumenty kanałowe w tacy myjącej i ułóż przewód fako luźno, z uwzględnieniem promienia gięcia, korzystając z uchwytów przy dolnej krawędzi tacy. Nie owijaj przewodu wokół szyny iniekcyjnej! Upewnij się, że silikonowe elementy (niebieskie i/lub białe) są rozmieszczone tak, aby instrumenty były mocowane przy jak najmniejszej liczbie punktów styku. Wtyk złącza rękojeści fako powinien być skierowany w dół, aby nie gromadziła się w nim woda. Jeśli producent tak zaleca, przyłącze należy zamknąć odpowiednią zaślepką.

Silikonowe elementy są zazwyczaj przycinane do wymaganej długości. Najlepiej użyć do tego ostrych nożyczek lub noża. Najpierw włóż uchwyty w kratkę jedną stroną nóżek, a następnie przeciśnij przez otwory drugą stronę nóżek.


4.




Szyna iniekcyjna MELA*store* Tray Ophthalmology jest zazwyczaj konfigurowana następująco:
Rękojeść fako (z przewodem i 1x Luer męski, 1x Luer Lock żeński), rękojeści ssąca i irygacyjna (z przewodem i 1x Luer męski, 1x Luer Lock żeński), kaniula irygacyjna (Luer Lock męski bezpośrednio na szynie iniekcyjnej), wkład irygacyjny do igły fako (Luer Lock męski bezpośrednio na szynie iniekcyjnej).

Jeżeli przyłącza nie są używane, należy je zamknąć śrubą zaślepiającą (nr art. ME80140). Jeśli są nieużywane tylko tymczasowo, dostępne są odpowiednie zaślepki (nr art. ME80170 dla Luer Lock męskiego, nr art. ME80180 dla Luer Lock żeńskiego).

5.

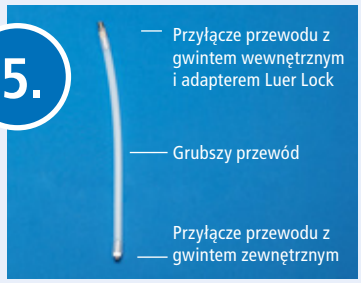

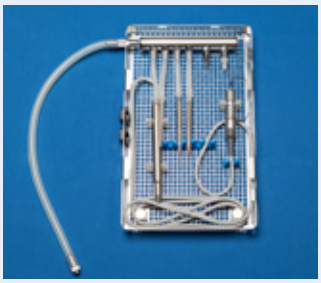


Podłącz grubszy przewód do zewnętrznej strony szyny iniekcyjnej tacy. Później przewód ten zostanie podłączony do szyny iniekcyjnej urządzenia MELA*therm*.

Grubsze przewody nie są skracane. Włóż adapter z przyłączem przewodu w oba końce przewodu, a następnie wkręć męski adapter Luer Lock w przyłącze przewodu z gwintem wewnętrznym.

Przewód łączący mocuje się do tacy, obracając go o ćwierć obrotu. Ilustracja ma charakter przykładowy. Przewód połączeniowy powinien pozostać w urządzeniu MELA*therm* podczas codziennej eksploatacji.


6.

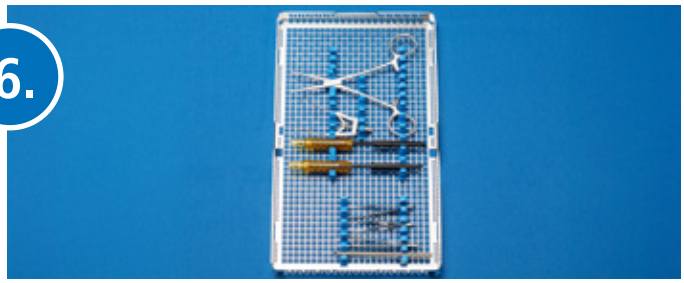

W przypadku instrumentów sztywnych i przegubowych niebieskie silikonowe elementy najlepiej umieścić wzdłużnie w górnym koszu bez szyny iniekcyjnej, tak aby instrumenty można było układać poprzecznie. Zapobiega to ich wysuwaniu się. Silikonowe elementy można dzielić według potrzeb, aby dopasować rozmieszczenie do indywidualnych wymagań.


Wskazówka: W przypadku stosowania bardzo delikatnych instrumentów można ułożyć dwa silikonowe elementy z przesunięciem względem siebie. Zapewnia to bezpieczne unieruchomienie instrumentów.

7.

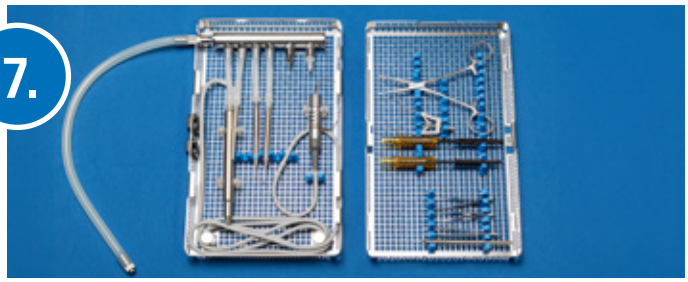

Konfiguracja górnego i dolnego kosza MELA*store* Tray Ophthalmology jest teraz zakończona. Taca powinna wyglądać podobnie do przykładu powyżej.

8.

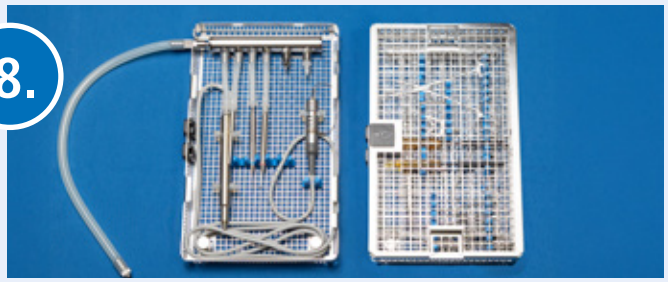

Zamknij górny kosz MELA*store* Tray Ophthalmology pokrywą sitową. W tym celu włóż zaczepy pokrywy w otwory tacy i dociśnij pokrywę do sita, aż usłyszysz kliknięcie blokady.

9.




Aby załadować do urządzenia MELA*therm* maksymalnie sześć tac MELA*store* Tray Ophthalmology, w koszu podstawowym z szyną iniekcyjną i plastikowym filtrem centralnym (nr art. ME80440) potrzebne są dwa uchwyty uniwersalne Flex 3 (nr art. ME80136).

Uchwyty na tace myjące należy włożyć tak, aby rama była pochylona w Twoją stronę, gdy patrzysz do komory mycia urządzenia MELA*therm*. Otwarty dolny kosz MELA*store* Tray Ophthalmology umieść po stronie szyny iniekcyjnej tak, aby przyłącze przewodu tacy myjącej znajdowało się u góry po prawej stronie. Następnie podłącz przewód urządzenia MELA*therm* do przyłącza w tacy myjącej. Zamknięte górne części MELA*store* Tray Ophthalmology umieszcza się po przeciwnej stronie.

Jeśli w jednym zestawie ma być regenerowanych więcej niż sześć instrumentów kanałowych, można je umieścić pojedynczo na szynie iniekcyjnej urządzenia MELA*therm*. Wymagane są do tego dodatkowe adaptery. Wszystkie pozostałe otwory w szynie iniekcyjnej kosza podstawowego urządzenia MELA*therm* należy zamknąć śrubami zaślepiającymi (nr art. ME80140).

10.

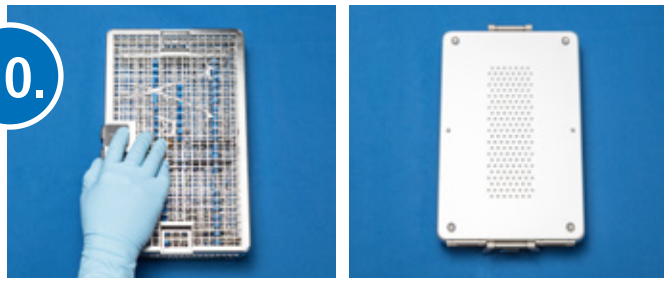

Po czyszczeniu i dezynfekcji instrumenty kanałowe należy osuszyć sprężonym powietrzem. Instrumenty kanałowe należy przedmuchać bezpośrednio przy przyłączu szyny iniekcyjnej MELA*store* Tray Ophthalmology. Zastosowanie papierka wskaźnikowego pH pomaga wykryć ewentualne pozostałości środków procesowych.

Następnie należy połączyć górny i dolny kosz MELA*store* Tray Ophthalmology. Zaczepy dolnej części wsuwają się w wycięcia górnej części. Najlepiej docisnąć górną część do dolnej płasko ułożoną dłonią, aż zatrzask zaskoczy.

Na koniec MELA*store* Tray Ophthalmology jest pakowana w MELA*store* Box 200 do sterylizacji.



Więcej informacji:
www.melag.com

MELAG
competence in hygiene

Rev.1-25/1439-06.25-PL-ME